


## Introduction

Pour les DMI, il existe 2 circuits distincts: un circuit DMI non stériles et un pour les DMI stériles:

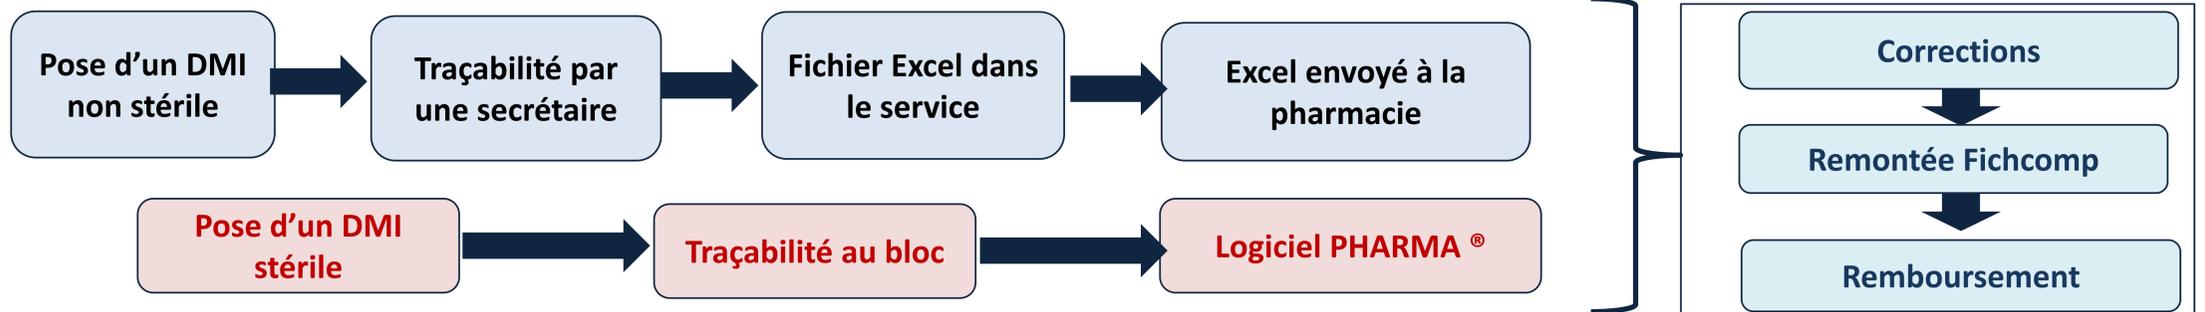

Lors du bilan financier de 2015, les DMI non stériles inscrits sur la liste en sus ont représenté une perte de 146 000€, contrairement au DMI stériles qui ne représente qu'une perte minime.

## Objectif

Evaluer la possibilité de tracer les DMI non stériles par l'intermédiaire du logiciel PHARMA®, comme pour les DMI stériles

## Matériel et méthodes

Groupe de travail: pharmacien, interne, référent bloc, cadre et informaticien


Recherche d'un circuit adapté aux DMI non stériles

Identification des gammes concernées

Définition du codage pour l'intégration au Fichcomp



## Résultats

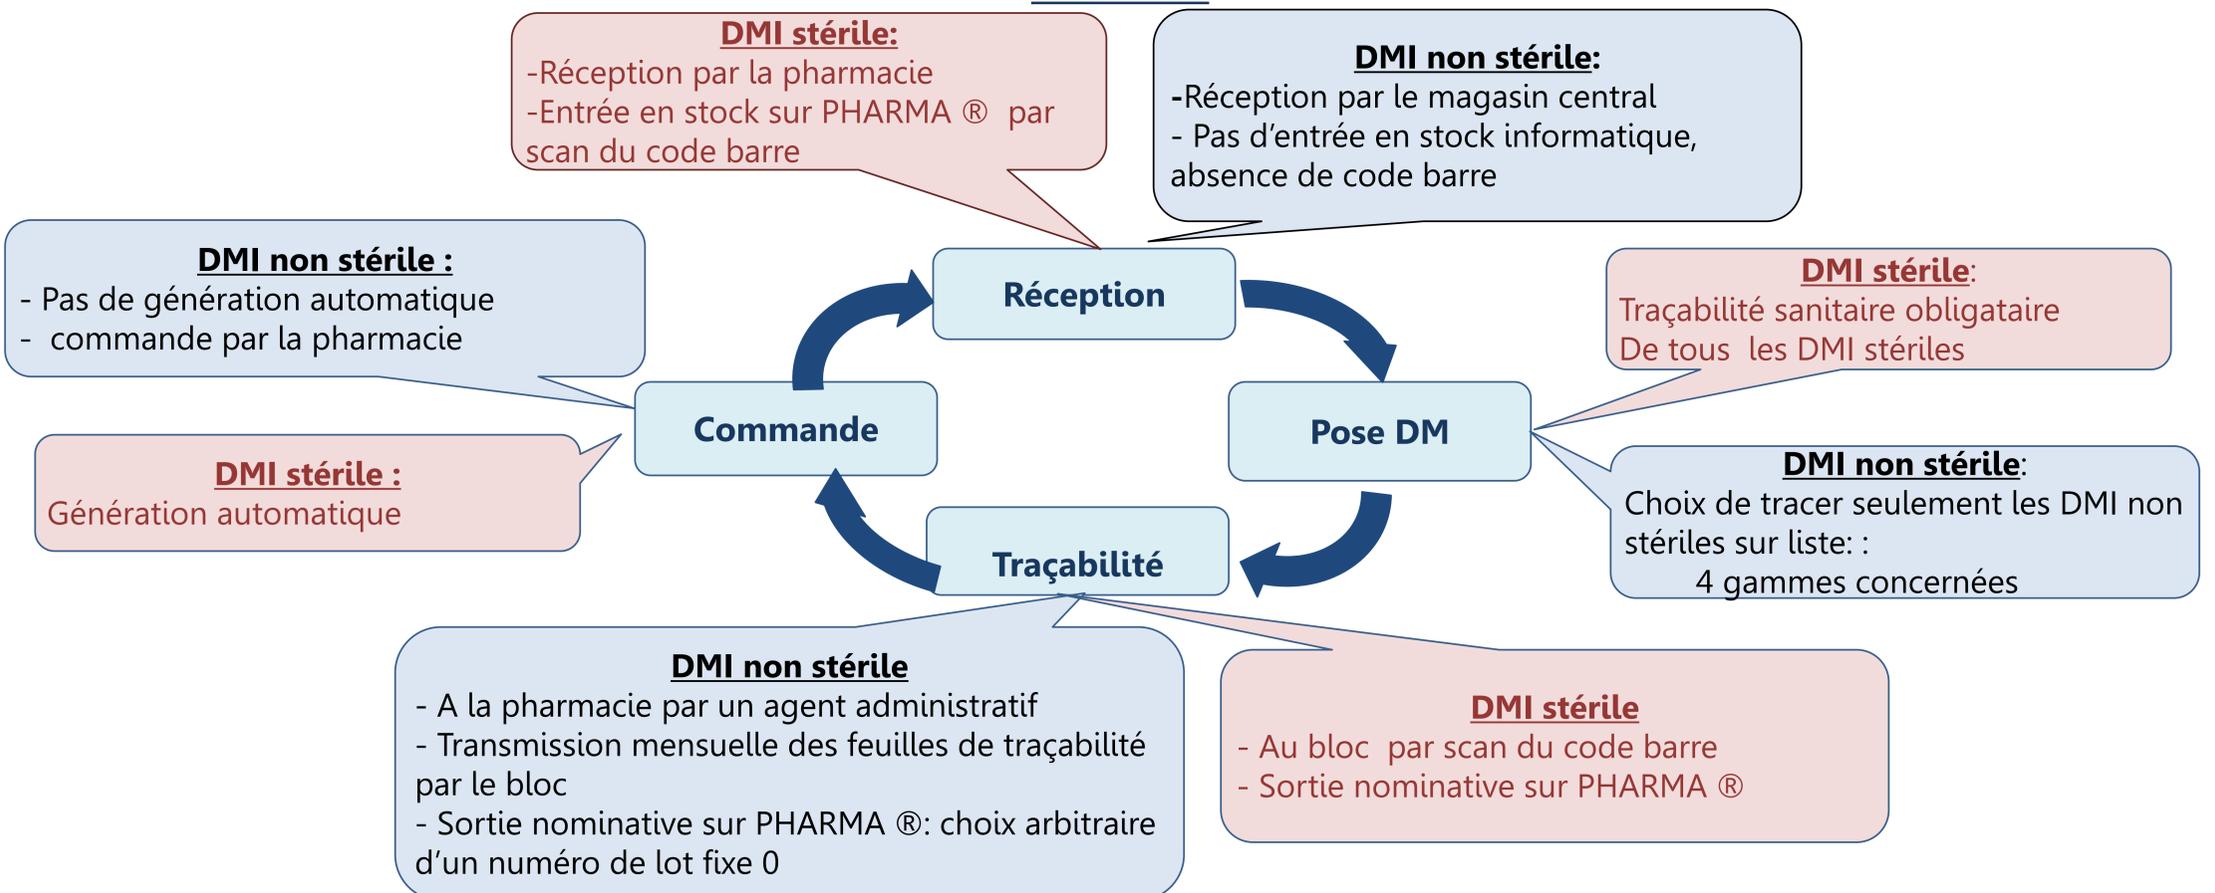

## Conclusion

La traçabilité informatisée dans PHARMA® permet un suivi plus régulier et rigoureux, afin de diminuer l'écart financier entre DMI achetés et tracés. Sa mise en place en fin d'année a permis de réduire partiellement l'écart en 2016, l'absence d'écart étant attendu en 2017