


MOTS CLÉS : IUD / Traçabilité / Informatisation

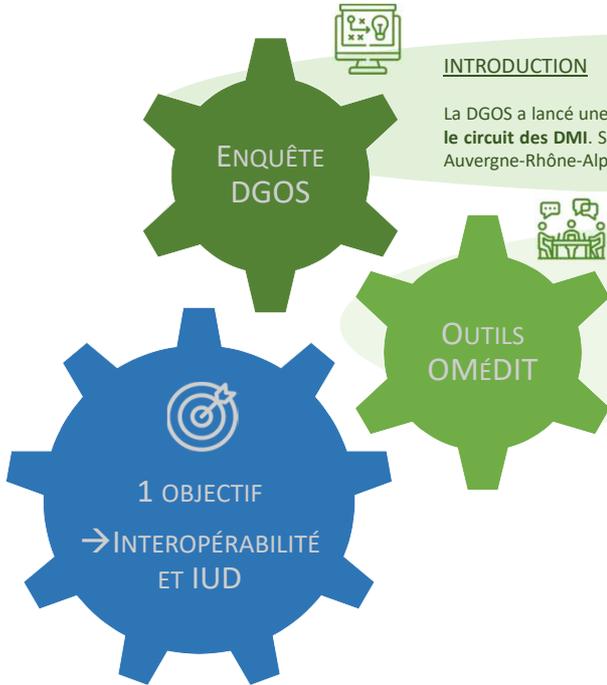


INTRODUCTION

La DGOS a lancé une expérimentation ayant pour objectif de **favoriser une montée en charge de la place de l'IUD dans le circuit des DMI**. Suite à cet appel national à candidature, **10 Etablissements de Santé (ES)** ont été retenus en région Auvergne-Rhône-Alpes (ARA).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Ces 10 ES ont été accompagnés par l'OMÉDIT ARA afin d'**identifier les freins et les leviers** du déploiement de l'IUD dans le circuit informatique des DMI. Pour ce faire, une **cartographie** et une trame de **workflow** ont été créées et complétées suite aux différents échanges. Ces outils devaient permettre d'identifier les équipements (matériels et informatiques) aux différentes étapes du circuit puis d'en évaluer l'optimisation et la place de l'IUD.

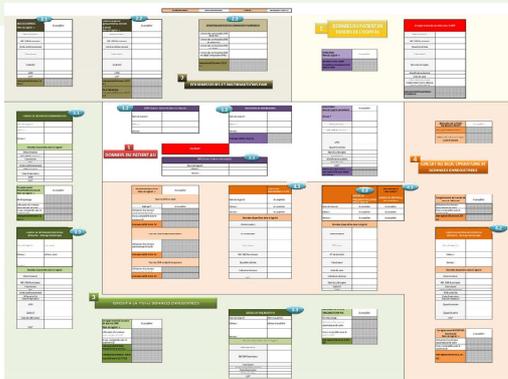

Outil OMÉDIT :
Cartographie du circuit informatique des dispositifs médicaux

RÉSULTATS - ÉTAT DES LIEUX RÉGIONAL

9 ES ONT RÉPONDU SUR LES 10 RETENUS


QUELS SONT LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES DES ES RÉPONDEURS ?

À la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)	Au Bloc Opérateur (BO)
Connexion à une base de données des DM 22% Logiciel de Gestion Economique et Financière (GEF) 100% Logiciel de gestion des stocks → Intégrant l'IUD 22% Logiciel de traçabilité sanitaire 69% → Intégrant l'IUD 88%	Logiciel de gestion des stocks 33%

QUEL EST L'ÉQUIPEMENT MATÉRIEL DES ES RÉPONDEURS ?

À la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)	Au Bloc Opérateur (BO)
Douchettes 78% → Compatibles IUD 57%	Douchettes 56% → Compatibles IUD 60%

QUELS SONT LES POINTS DE RUPTURE IDENTIFIÉS ?

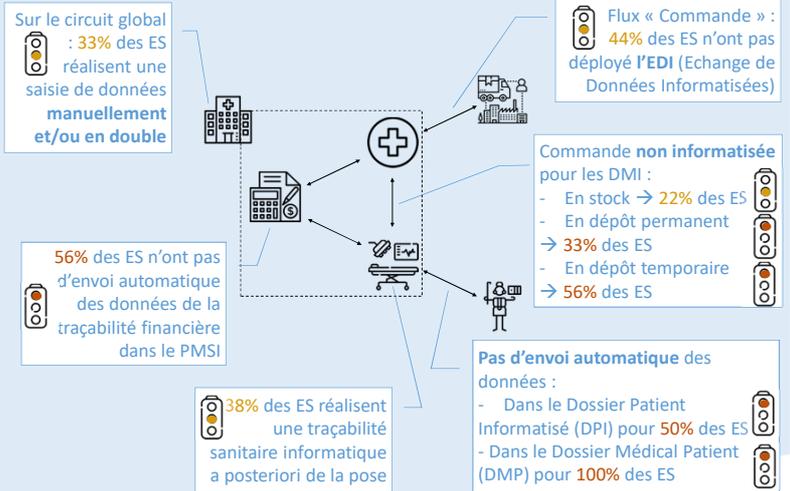

DISCUSSION - DIAGNOSTIC RÉGIONAL

L'analyse groupée des circuits de ces 9 ES met en évidence les constats suivants :

- ⚠ Tous les logiciels **n'intègrent pas** l'IUD
- ⚠ Toutes les douchettes ne sont **pas compatibles** avec la lecture de l'IUD
- ⚠ La lecture de l'IUD ne permet pas d'**améliorer** le circuit des DMI en dépôt temporaire
- ✅ Les éditeurs ont développé des **nouvelles versions** de logiciels intégrant l'IUD
- ✅ La traçabilité sanitaire est **optimisée** dès la mise en place de la lecture de l'IUD

CONCLUSION - PLAN D'ACTION RÉGIONAL

Animation d'un groupe de travail OMÉDIT avec des pharmaciens hospitaliers afin de créer des outils répondant aux objectifs suivants :

- **Sensibiliser** les directions et les opérateurs
- **Recenser** les informations sur les niveaux d'interfaçage des logiciels d'interopérabilité
- ✂ **Création** de documents de communication sur l'IUD et son déploiement
- ✂ **Elaboration** d'une liste des logiciels des établissements de la région avec précision du niveau