


Mots clés : Pansements, Dialyse, Essai

INTRODUCTION


- KT central de dialyse concerne 30% des patients hémodialysés
- Pratique actuelle : pas de pansement spécifique, utilisation de films en PUR + compresses
- PROBLÉMATIQUE** : certains patients reviennent avec leur pansement décollé (partiellement ou totalement) → augmentation du risque d'infection

OBJECTIF

- Recherche d'un pansement pour KT de dialyse avec :
 - ☐ Bonne tenue, émergence du KT visible
 - ☐ Adapté pour l'équipe médico-soignante et pour les patients
 - ☐ Surcoût maîtrisé par rapport au pansement actuel

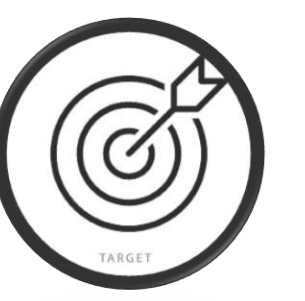

MATERIEL & METHODE



PANSEMENTS TESTES

Trois pansements de trois fournisseurs différents testés

Lien pour accéder à la fiche d'évaluation →




FICHE D'ÉVALUATION A DESTINATION DES IDE

- ✓ Critères de pose
 - ☐ Identification de l'emballage
 - ☐ Pelabilité
 - ☐ Facilité de pose
 - ☐ Visibilité de l'émergence
 - ☐ Adhésivité
 - ☐ Taille
- ✓ Critères de retrait
 - ☐ Facilité de retrait
 - ☐ Tolérance
 - ☐ Étanchéité
 - ☐ Tenue
 - ☐ Confort
- ✓ Note globale
- ✓ Avis IDE



ANALYSE DES RESULTATS & IMPACT ECONOMIQUE

- Comparaison des évaluations par un score pour la pose, pour le retrait et un score général
- Avis IDE et patients pris en compte
- Analyse coût et surcoût pour pansement le mieux évalué



MISE EN PLACE DE L'ESSAI

- Où ? Service d'Hémodialyse
- Quand ? Du 19/07/2021 au 22/08/2021 (4 semaines)

RESULTATS

- ❖ **POPULATION** : 16 patients – moyenne âge : 69,6 ans [36-87] – Sex-ratio H/F : 1
- ❖ **TYPE DE KT** : jugulaire n=15 (93,8%) ; fémoral n=1 (6,2%)

PANSEMENT 1



n=16/16

EVALUATION : **8,3/10**

N°1

- Pose : 8,7/10
- Retrait : 7,9/10
- Satisfaction IDE : 75%

AVANTAGES

- Étanche, ajustable à la taille du KT, peu de colle, visibilité émergence

INCONVENIENTS

- Pose complexe, mobile, intolérance cutanée (n=3/16 ; 18,7%)

PRIX HT

- 3,50 €

PANSEMENT 2



n=16/16

EVALUATION : **7,6/10**

N°2

- Pose : 7,7/10
- Retrait : 7,5/10
- Satisfaction IDE : 62,5%

AVANTAGES

- Étanche, confort, peu de colle

INCONVENIENTS

- Pas de visibilité de l'émergence, intolérance cutanée (n=3/16 ; 18,7%), mobile

PRIX HT

- 2,40 €

PANSEMENT 3



n=14/16

EVALUATION : **7,5/10**

N°3

- Pose : 9,2/10
- Retrait : 5,9/10
- Satisfaction IDE : 43,8%

AVANTAGES

- Visibilité émergence, confort

INCONVENIENTS

- Transparence, condensation, beaucoup de colle, intolérance cutanée (n=2/14 ; 14,3%)

PRIX HT

- 2,90 €

ANALYSE SURCÔÛT

PANSEMENT 1

3,50 €

Pansement actuel
0,56 €

Surcoût pour un
pansement
2,94 €

Surcoût annuel par
patient
(≈ 3 séances/ sem)
458 €

Surcoût annuel
pour le service
7 330 €

DISCUSSION & CONCLUSION

- Le **PANSEMENT 1** regroupe les critères recherchés pour un pansement de KT de dialyse :
 - ✓ émergence visible
 - ✓ adaptabilité à la longueur du KT
 - ✓ bonne tolérance cutanée
 - ✓ bonne étanchéité
- Manipulation plus complexe (deux parties distinctes) et coût du dispositif → frein au référencement et à la modification du protocole actuel

→ Le référencement pour une utilisation en seconde intention est envisagé pour les patients revenant régulièrement avec leur pansement décollé et donc plus à risque d'infection de KT