


Exploration des utilisations de l'huile de vaseline en ampoules, un dispositif médical stérile

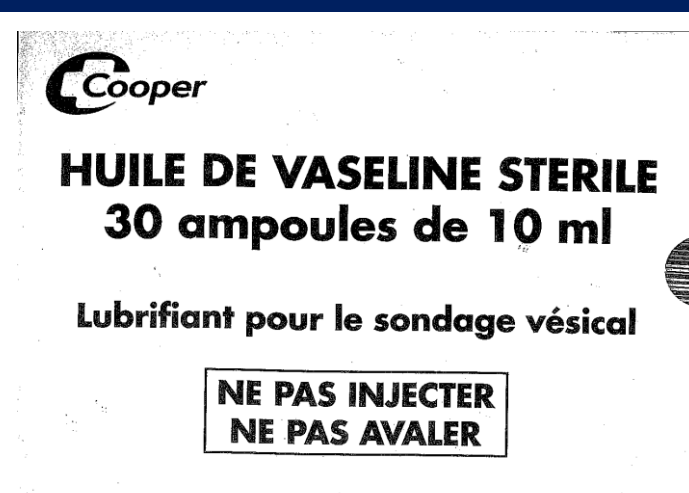

L. Lamrous, J.E. Fontan, A.C. Steinmetz

Service de Pharmacie, Unité des Dispositifs Médicaux, Hôpital Lariboisière, APHP, Paris

lilliamrous9@gmail.com

Mots clés : Bonnes pratiques, mésusage, indication



INTRODUCTION

L'huile de vaseline stérile Cooper est un dispositif médical de classe IIa destiné d'après l'étiquetage à la « lubrification pour sondage vésical ». Pour cette même indication, notre Unité des Dispositifs Médicaux référence un gel lubrifiant non huileux en tube (Optilube®) et un set de sondage contenant une dose de gel lubrifiant.

OBJECTIFS

- ➔ Déterminer les **utilisations** de l'huile de vaseline en ampoules afin d'éviter les mésusages
- ➔ Rechercher des **alternatives** et adapter l'offre aux besoins des services

MATERIEL ET METHODE

UTILISATIONS

Analyse des consommations d'huile de vaseline stérile entre 2019 et 2021

Enquête téléphonique auprès de 3 services pour définir les items du questionnaire

Rédaction du questionnaire

Distribution des questionnaires (1/service) à un.e IDE ou un.e cadre

ALTERNATIVES

Analyse des consommations d'huile de vaseline stérile dans les hôpitaux de l'APHP

Etude du catalogue de l'AGEPS et de la composition du matériel pour sondage et lavements

Recueil du protocole de lavement à Lariboisière

RESULTATS

SERVICE DE PHARMACIE
UNITÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Hôpitaux Universitaires
SAINT-LOUIS
LARIBOISIÈRE
FERNAND-WIDAL

QUESTIONNAIRE UTILISATION HUILE DE VASELINE EN AMPOULES

Service :

Dans quel usage l'huile de vaseline est-elle principalement utilisée dans votre service ?

☐ Lubrification pour sondage urinaire
☐ Lavements
☐ Touchers rectaux
☐ Autre (veuillez détailler) :

Dans quels autres usages l'huile de vaseline est-elle utilisée dans votre service ?

☐ Lubrification pour sondage urinaire
☐ Lavements
☐ Touchers rectaux
☐ Autre (veuillez détailler) :

Si vous utilisez l'huile de vaseline pour le sondage urinaire

Utilisez-vous également ces produits ?

☐ Set de sondage
☐ Optilub

Pourquoi utilisez-vous l'huile de vaseline plutôt que le set de sondage ou Optilub ?

.....

Si vous utilisez l'huile de vaseline pour réaliser des lavements

Utilisez-vous également le Normacol ?

☐ Oui
☐ Non

Pourquoi utilisez-vous l'huile de vaseline plutôt que le Normacol ?

.....

L'huile de vaseline vous semble-t-elle indispensable ?

☐ Oui
☐ Non


Remarques :

.....

Merci de votre participation.

Rédigé par Lilia Lamrous - 14-02-2022

Utilisations principales d'huile de vaseline stérile dans les services

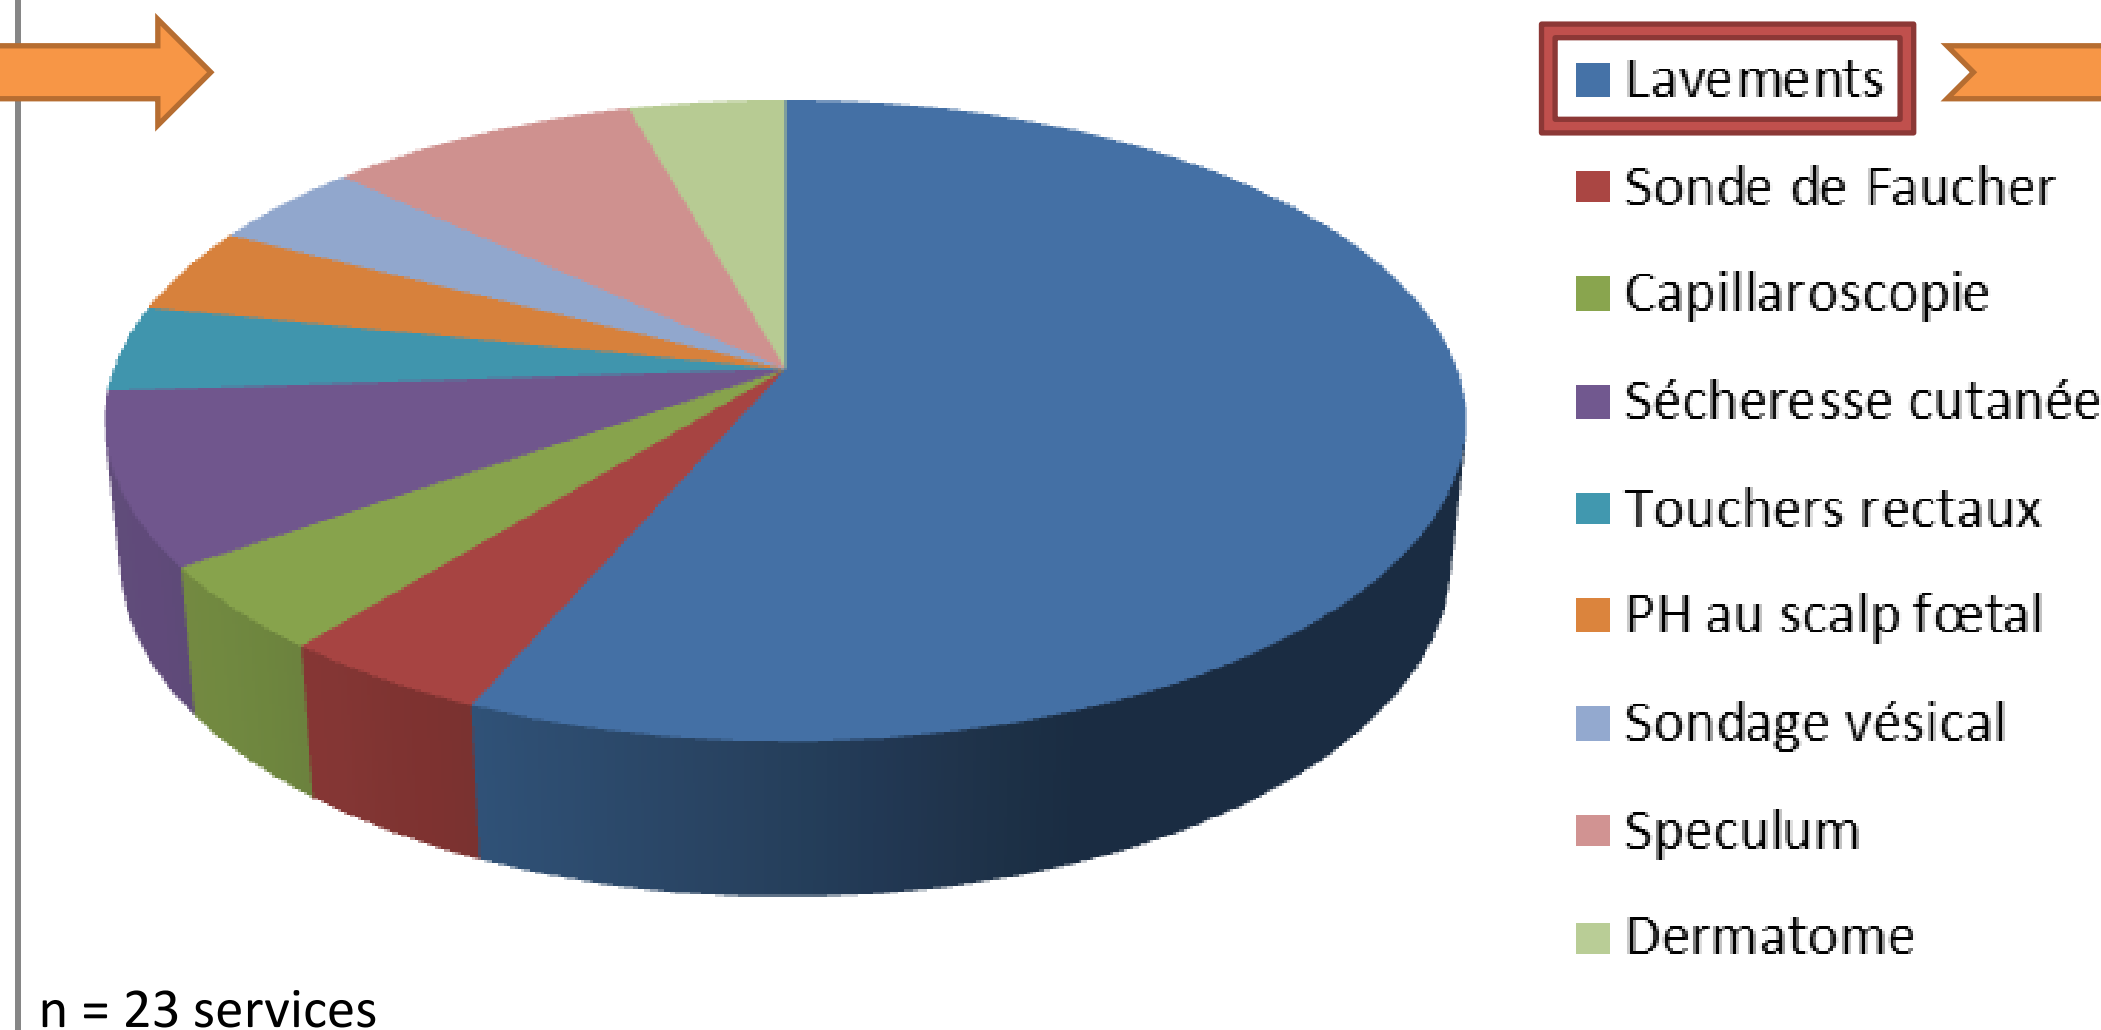

Indication du fabricant « lubrification pour sondage urinaire » ➔ sauf exception **NON**

Recommandations CODIMS : gel lubrifiant hydrophile, proscrire l'huile de vaseline pour les sondes en latex car risque de fragilisation par porosité

DM utilisés dans cette indication : Optilube®, set de sondage contenant Optilube®

La question des lavements

En 2^{ème} intention après un lavement au Normacol® en cas d'inefficacité

Lavement par iléostomie ou par le rectum en l'absence d'occlusion dans une poche de lavement de 2 litres :

- ▶ 1 litre d'eau tiède
- ▶ 4 ampoules d'huile de vaseline
- ▶ +/- Normacol®

VASELINE OU PARAFFINE ?

Libellé	Indication
HUILE DE VASELINE STÉRILISÉE AMPOULE 10 ML - BOITE DE 30 AMPOULES	Lubrification pour sondage vésical
PARAFFINE + VASELINE + GLYCEROL CREME	Dermatoses
VASELINE STÉRILISÉE COOPER POMMADE TUBE DE 20 G - GRP	Irritations/sécheresses
VASELINE OFFICINALE CPF POMMADE TB 45G	Irritations/sécheresses



Spécialités contenant de la paraffine

Libellé
HUILE DE PARAFFINE GIL SOL BUV FL 500ML
HUILE DE PARAFFINE GIL SOL BUV FL 250ML

Prix de 6 flacons d'huile de paraffine de 250 ml

Prix d'1 boîte de 30 ampoules de 10 ml d'huile de vaseline

DISCUSSION

Alternatives pour usages spécifiques :

- ▶ Toucher rectal ➔ vaseline en tube
- ▶ PH scalp en gynécologie ➔ sets pour PH
- ▶ Lubrification de tube de Faucher ➔ Optilube® (DM)
- ▶ Capillaroscopie n'est plus pratiquée
- ▶ Sécheresse cutanée ➔ Dexeryl® (médicament)
- ▶ Lubrification d'instruments de bloc ➔ Sterilub® (DM)



Présente au livret de nombreux hôpitaux. A Lariboisière, uniquement en flacons de 500 ml pour l'extraction de boulettes de stupéfiants en Réanimation Médicale.

CONCLUSION

L'usage principal de l'huile de vaseline n'est pas dans l'indication mentionnée sur l'étiquetage. L'huile de vaseline est vouée à la préparation de « grands lavements » pour des patients chez qui un lavement au Normacol® seul ne suffit pas ➔ conditionnement en ampoules non adapté : petits volumes pour un grand volume recherché.

A VENIR

- Protocole de lavement actuellement en révision
- Référencement de l'huile de paraffine 250 ml
- Proposition d'alternatives aux services en fonction de leur usage