

S. COUDUN⁽¹⁾, S. LE POOLE⁽¹⁾, T. BREBANT⁽²⁾, B. BONAN⁽²⁾, E. VIRIOT⁽¹⁾

⁽¹⁾Service Pharmacie, Centre hospitalier Courbevoie Neuilly Puteaux (CHCNP), Neuilly sur Seine

⁽²⁾Service Stérilisation, Hôpital Foch, Suresnes
scoudun@aol.com

INTRODUCTION – OBJECTIFS


Depuis 2004, le CHCNP sous-traite la stérilisation à l'hôpital Foch. Suite aux signalements de défauts-qualité significatifs sur des hystéscopes achetés pour le service de consultation de gynécologie et nouvellement référencés, nous avons réalisé une analyse des risques liés au retraitement de ces dispositifs médicaux (DM) à l'optique fragile, afin de dégager des pistes d'amélioration.

MATERIELS ET METHODE

→ Analyse rétrospective de l'événement indésirable selon le modèle de la méthode ALARM


→ Recherche des risques attenants à chaque étape du processus de stérilisation par les pharmaciens des deux sites

Figure 1 : Les 7 thèmes de la grille ALARM

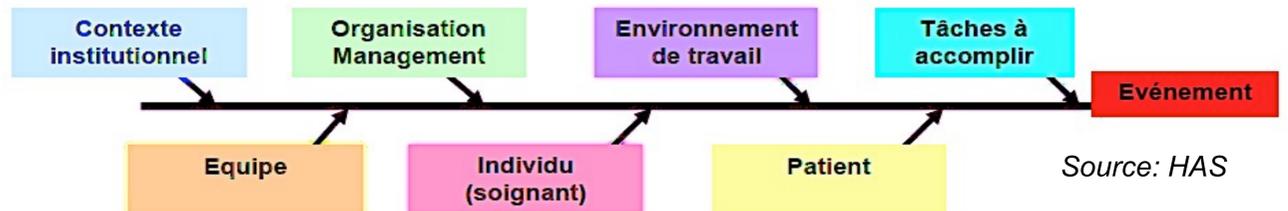

RESULTATS – DISCUSSION

Figure 2 : Logigramme reprenant le processus, les intervenants et les risques associés à chaque étape

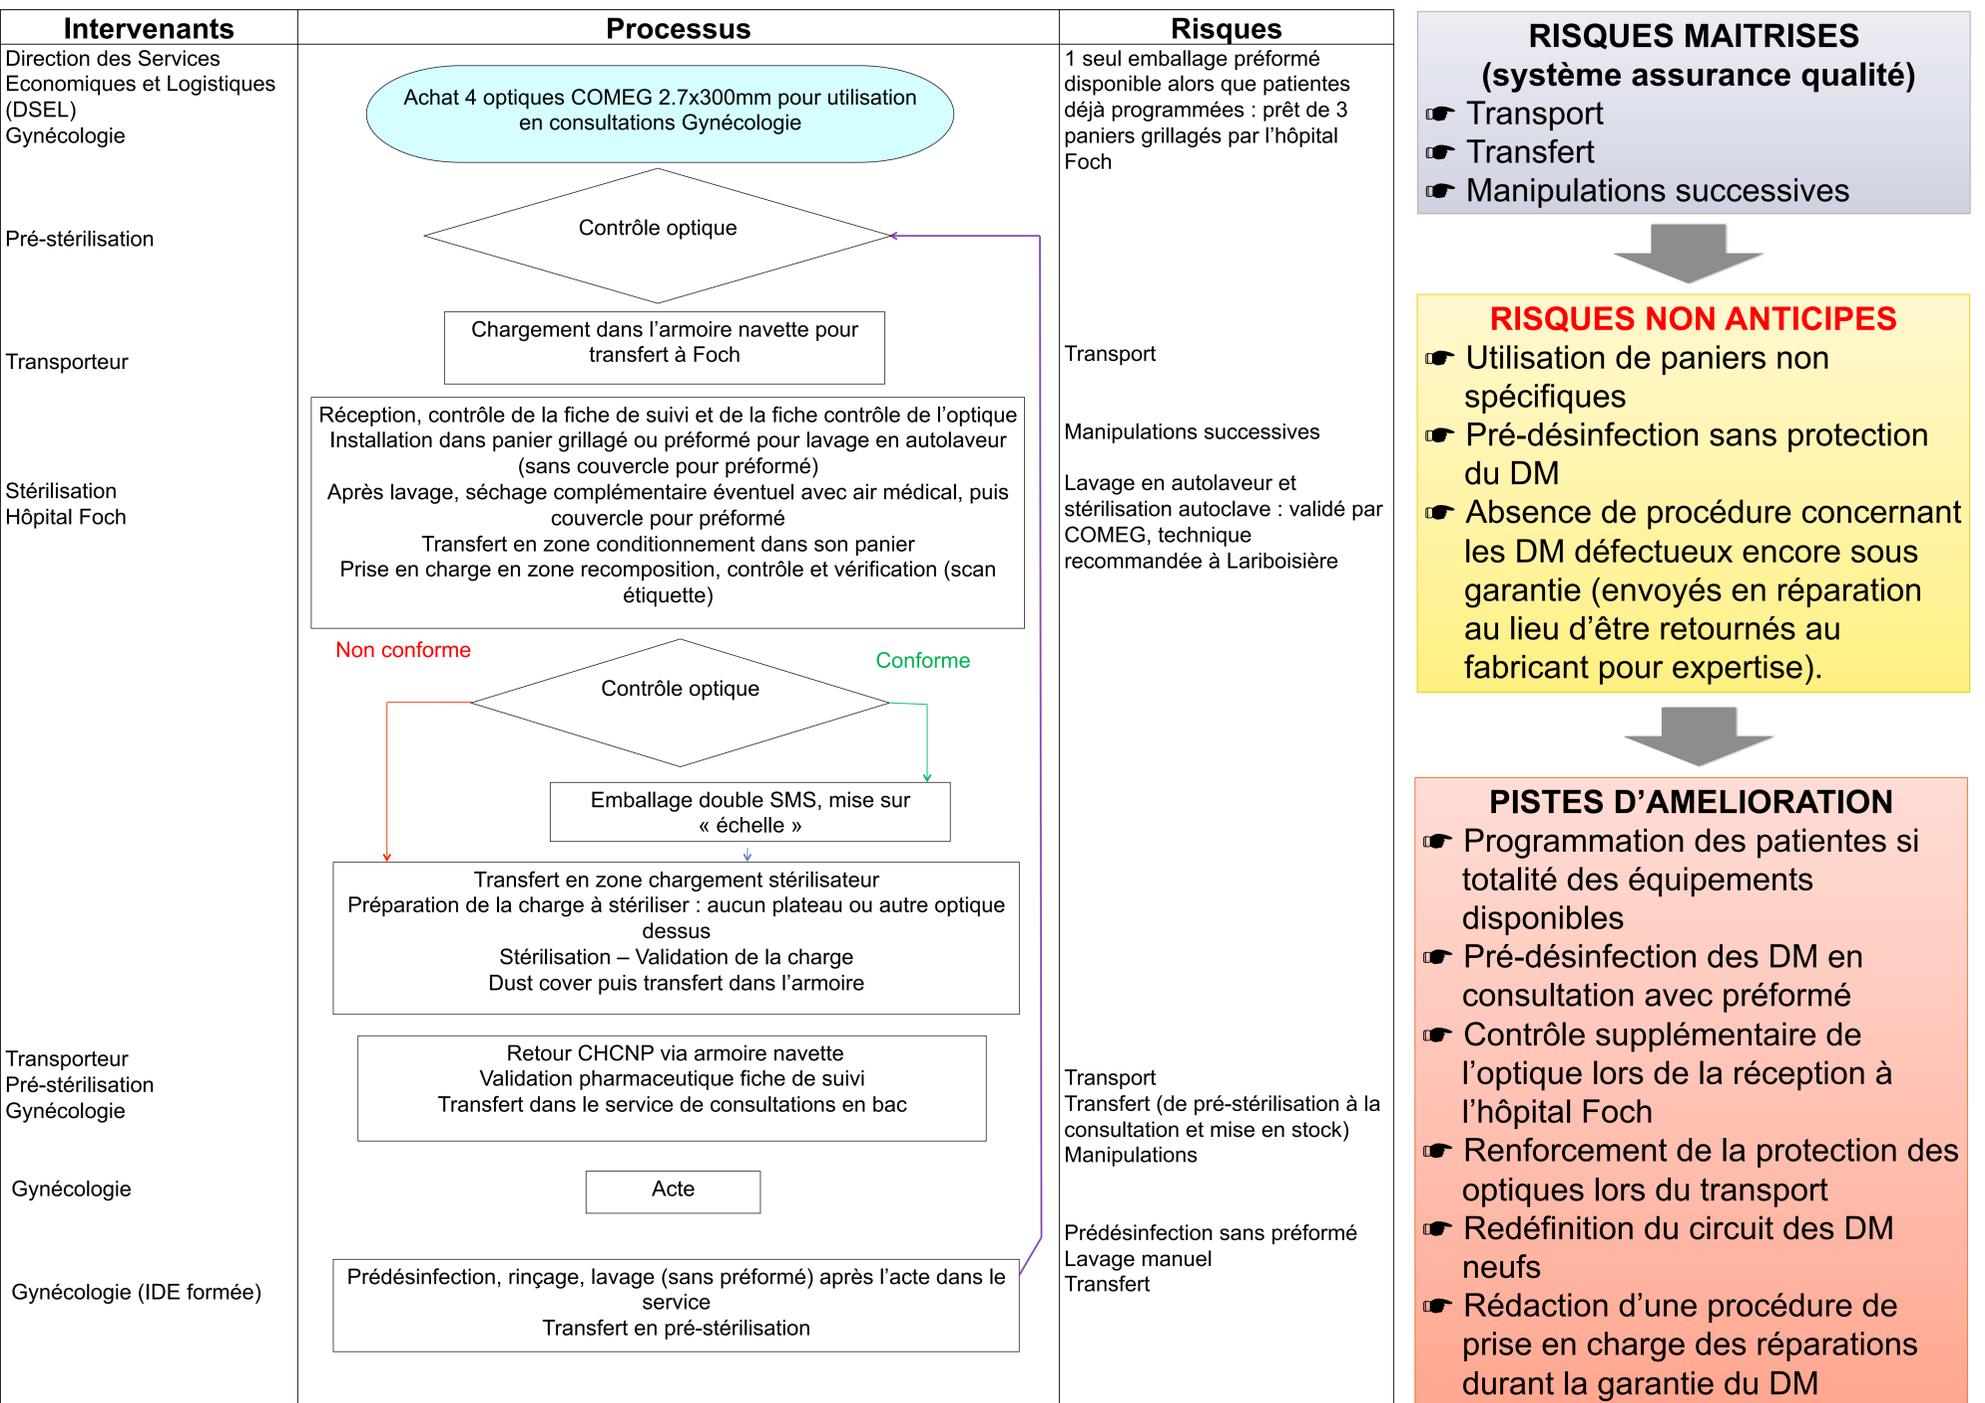

CONCLUSION

Il est primordial de référencer et de mettre à disposition un DM uniquement après validation de l'ensemble des étapes du processus. Le pharmacien doit être impliqué même s'il n'est pas l'acheteur (DM non stérile). En effet, il dispose d'une vision globale sur le cycle de vie d'un DM ainsi que sur les risques associés.



MÊME SI LES RESPONSABLES N'ONT PAS PU ÊTRE IDENTIFIÉS, LE CIRCUIT A ÉTÉ SÉCURISÉ AVEC L'ENSEMBLE DES ACTEURS CONCERNÉS.