



Y.Peyroux⁽¹⁾, M. Andanson-Macchi⁽¹⁾, JP. Bierjon⁽²⁾, M.Scribe-Outtas⁽³⁾, JM.Bredon⁽⁴⁾

(1) Pharmacie à Usage Intérieur, (2) Bloc opératoire, (3) Endoscopie Digestive, (4) Directeur référent pôle médico-technique



Introduction / Objectifs

En octobre 2013, le changement du mode de fonctionnement en endoscopie digestive a permis d'engager une réflexion sur une optimisation de la gestion des dispositifs médicaux (DM) et la sécurisation du circuit. La mise en place du système plein/vide (PV) pour le stock et l'informatisation des commandes ont permis d'atteindre ces objectifs.

Matériels et méthodes



Résultats

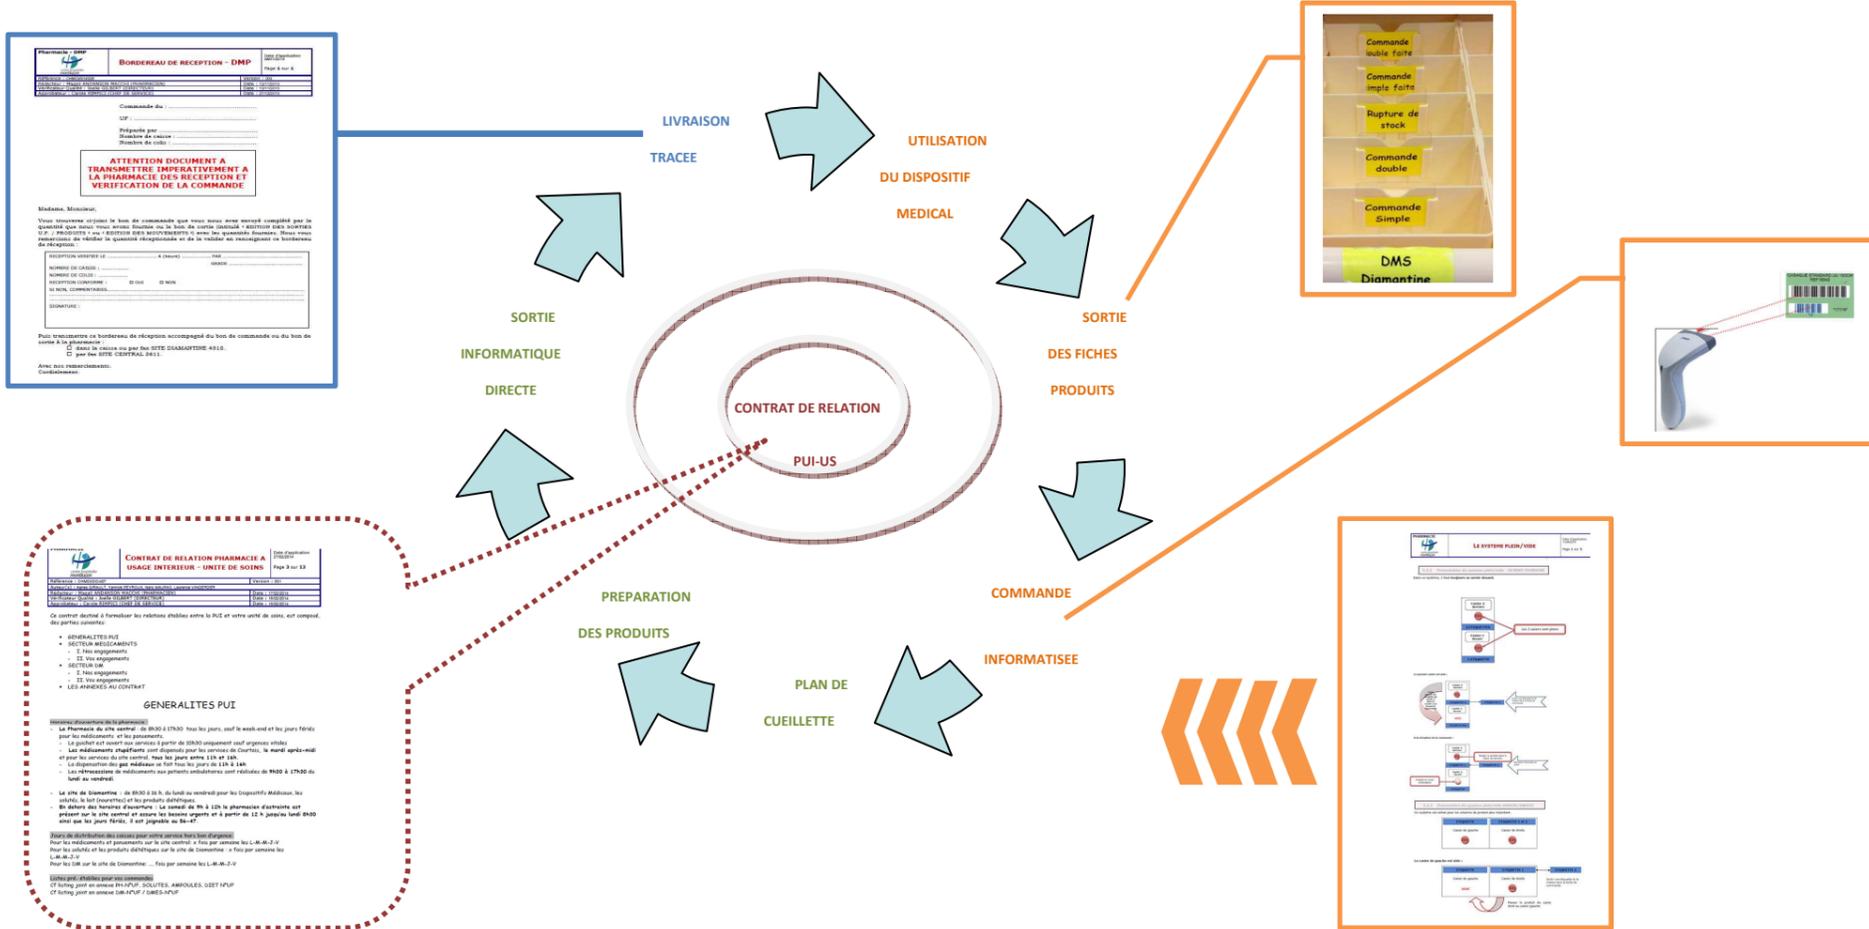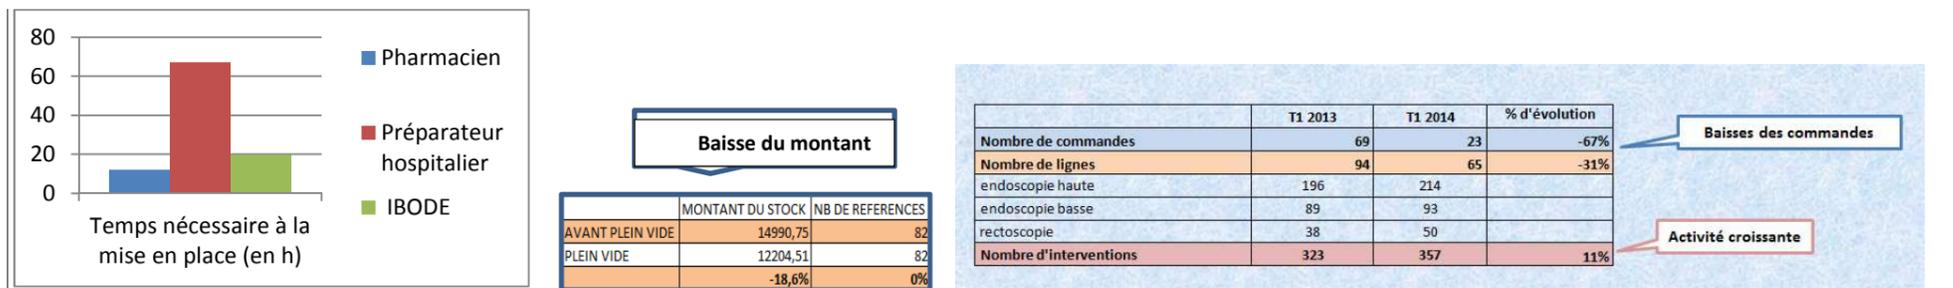

Discussion - Conclusion

Cette réorganisation a permis de redéfinir la liste des DM à détenir en stock et de renforcer les relations PUI-Unité de soins par la signature d'un contrat. Une formation sur le fonctionnement PV et sur la commande informatisée a été organisée en insistant sur la nécessité de rigueur.