

J Heitzmann\*, M Ouvrier\*\*, A Duchaussoy\*\*, G Vary\*\*, S Nguyen\*\*\*, F Guerin\*\*  
 \*Interne en pharmacie, \*\*Pharmacien PUI, \*\*\* Pharmacien hygiéniste, CH Anancy Genevois (CHANGE)  
[justine.heitzmann@orange.fr](mailto:justine.heitzmann@orange.fr)


## INTRODUCTION :

Notre établissement bi-site réalise environ 150 hystérosopies diagnostiques et thérapeutiques par an.  
 En l'espace d'un mois, **10 fiches d'évènements indésirables ont été rédigées** suite à des problèmes de casse d'optiques ou d'absence de chemises à l'ouverture des boites d'hystérosopies.

## OBJECTIF :

Sans se dispenser d'une étude approfondie du circuit de stérilisation des boites d'hystérosopies, une solution est d'étudier le **référencement d'un kit de gynécologie à usage unique (UU)** afin de s'affranchir de leur passage en stérilisation.


## MATERIELS ET METHODES :

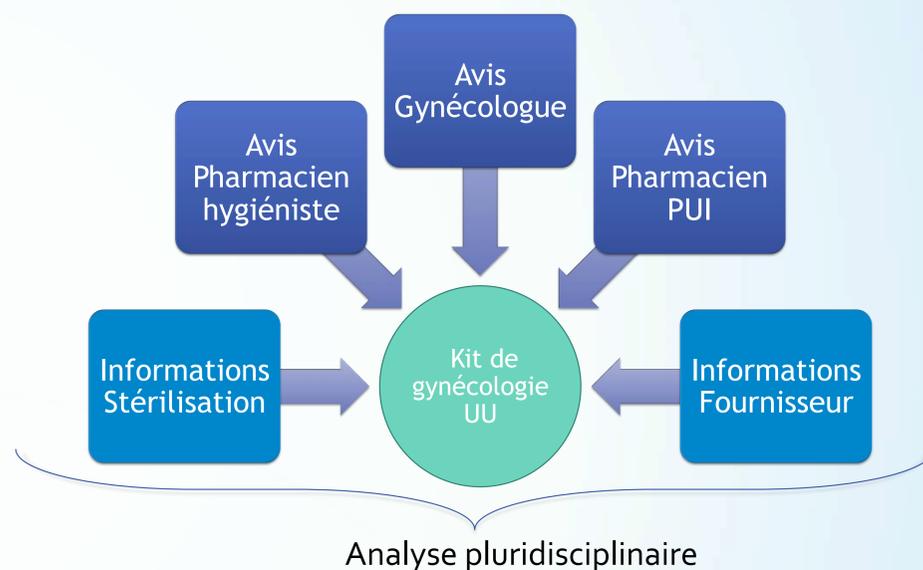

## RESULTATS :

A notre connaissance, un seul kit de gynécologie UU est aujourd'hui proposé sur le marché captif d'un optique 2,7 mm, 30°.

### ➤ Hystéroscope équipé d'un kit de gynécologie UU :

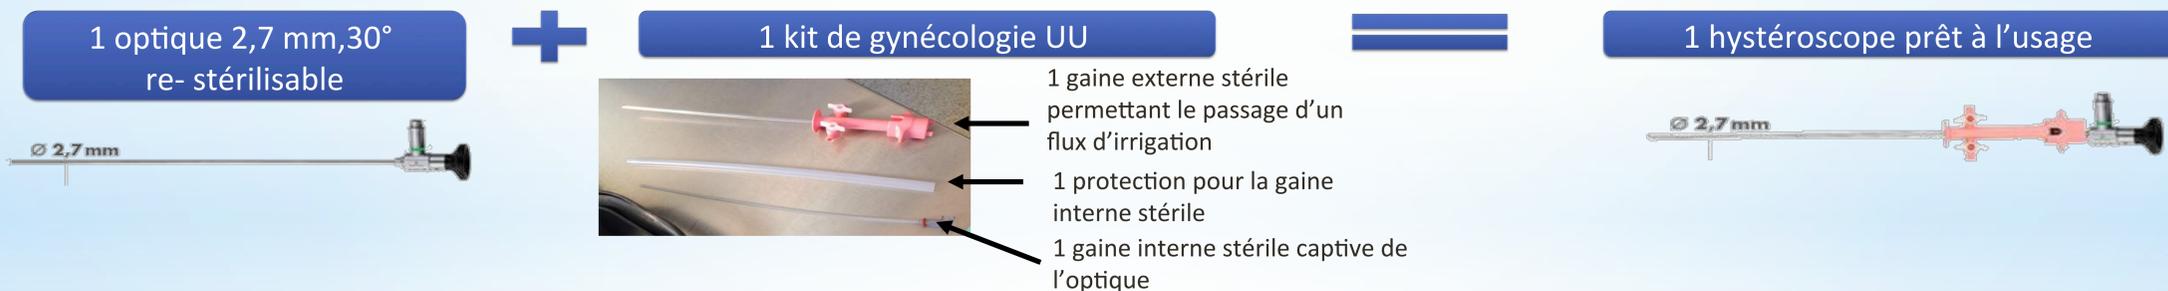

### ➤ Hystéroscope équipé de manière habituel :



On réalise plus de 76 hystérosopies diagnostiques par an, sur les 2 sites, nécessitant l'utilisation des boites d'hystérosopies :

Utilisation de la boîte sans le kit		Utilisation de la boîte avec le kit	
Matériels	Méthodes	Matériels	Méthodes
1 optique	Stérilisation entre chaque acte	1 optique captif du kit UU (2,7mm, 30°)	Achat de l'optique
1 chemise d'examen		1 kit de gynécologie UU	Stérilisation en fin de journée
1 câble lumière		1 câble lumière	Jeté une fois utilisé
1 speculum vaginal		1 speculum vaginal	Stérilisation entre chaque acte
1 pince Longuette		1 pince Longuette	
1 pince Pozzi	1 pince Pozzi		
Coût total minimum pour 2017 = 2131€ HT		Coût total minimum pour 2017 = 6295€ HT	
Surcoût minimum de 4165€ HT pour 2017 (en tenant compte de l'achat d'un seul optique) Surcoût minimum de 2347€ HT pour les années suivantes (réutilisation de l'optique acheté)			

### Avantages du kit

- Évite le passage en stérilisation de l'optique selon le fournisseur
- Facilité d'utilisation décrite par le gynécologue
- Remplace la chemise d'examen

### Inconvénients du kit

- Surcoût estimé à 4165 € HT en 2017
- Captif d'un optique de 2,7mm, 30°
- Uniquement pour l'hystérosopie diagnostique
- Déconseillé chez les femmes nullipares et à col sténosé
- Avis défavorable de l'hygiène (Recommandations SF2H juin 2016)\*

\* « Stériliser tout dispositif médical réutilisable dès lors qu'il doit être utilisé stérile »

## DISCUSSION/ CONCLUSION :

Face aux inconvénients d'utilisation du kit UU, à son surcoût et aux arguments avancés par l'hygiène, **nous n'avons pas souhaité référencer ce kit**. Par ailleurs, des actions correctrices mises en place au sein du circuit de stérilisation des boites d'hystérosopies ont permis de résoudre les problèmes initiaux de stérilisation.