

STANDARDISATION DES CONSOMMABLES REUTILISABLES POUR MONITEURS DE PRISE DE TENSION : PERFORMANCE SANS SURCÔT



P. Joret¹, S. Drouot¹, S. Frontini¹, S. Raspaud¹, A-M. Taburet¹

¹ Pharmacie - CHU Bicêtre, HUPS, AP-HP, 78 rue du Général Leclerc 94275 LE KREMLIN-BICETRE Cedex



CONTEXTE

Le parc d'un hôpital de 1100 lits (Adultes et Enfants) est de **362** moniteurs de prise de tension, **29** modèles, **13** fabricants nécessitant **48** références de brassards non stériles réutilisables

Standardisation décidée par le COMEDIMS

Déploiement d'une gamme de brassards à raccord universel (connecteur spécifique du moniteur et brassard unique)
→ 8 brassards utilisables sur tout type de moniteur

OBJECTIFS


- ✓ Améliorer la qualité des soins par la simplification de l'utilisation du matériel par les soignants
- ✓ Evaluer l'impact économique d'un tel déploiement
- ✓ Evaluer la plus-value d'une gestion centralisée de ces consommables par la PUI en regard d'autres circuits en place dans d'autres Etablissements de Santé (ES).

MATERIELS & METHODES


- Avant standardisation : recensement des moniteurs, état des brassards (bon état, légèrement détérioré, vétuste)
- Standardisation des brassards en octobre 2011 : centralisation des consommables par la PUI et mise à disposition du matériel dans les services avec formation du personnel infirmier
- Après standardisation : enquête de satisfaction à 3 mois dans dix unités de soins (3 pédiatriques, 7 adultes dont les urgences), sélectionnées sur 3 paramètres : nombre (nb) de moniteurs, nb de modèles et nb de mesures de la tension
- Evaluation de l'impact financier du déploiement par rapport aux consommations relevées de 01/2010 à 10/2011 à l'aide du logiciel SAP (amortissement sur 3 ans)
- Enquête téléphonique auprès des gestionnaires de DM de 18 ES de proximité (10 CHU et 8 CHG)

RESULTATS

Etat des brassards

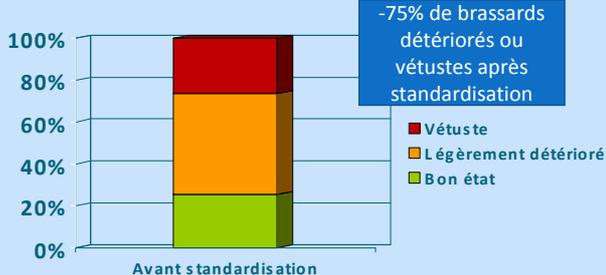


Enquête de satisfaction

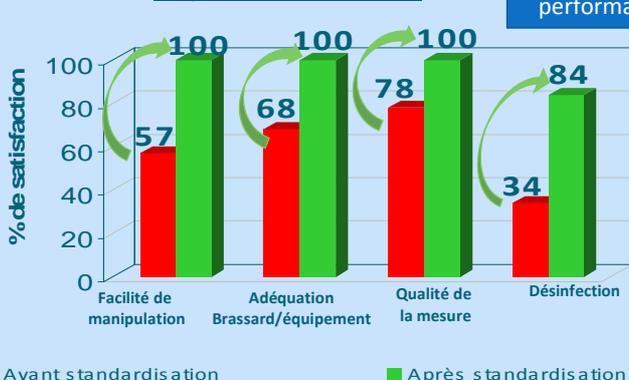

Nombre de références de brassard

% rapporté au nombre de moniteurs par service

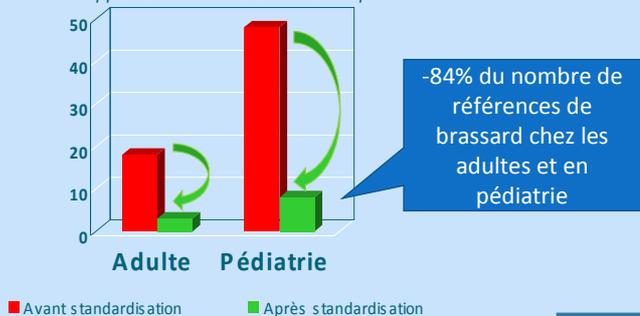


Coût du déploiement sur 3 ans

Coût des brassards (en €)	Standardisation	Coût actuel
1 ^{ère} année	10 333 €	2 862 €
2 ^{ème} année	0	2 862 €
3 ^{ème} année	0	2 862 €
Coût global	10 333 €	8 588 €

Durée marché : 3 ans
 Durée moyenne d'utilisation du brassard : 3 ans

+27% → **+ 1 745 € à 3 ans**

La gestion des brassards dans 18 ES

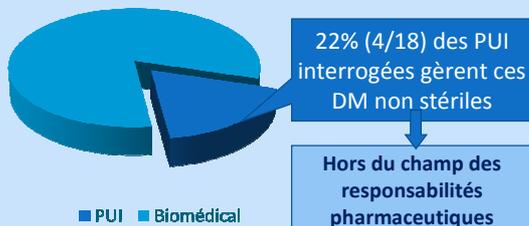

CONCLUSION

La gestion de ces consommables engage un partage de responsabilité entre équipe de soins, EOH, atelier biomédical et PUI.

La centralisation par la PUI engendre un gain en terme de :

- logistique (-84% de références)
- sécurité des soins (brassard neuf et adapté)
- satisfaction complète des services (80% sont très satisfaits, 20% satisfaits)

pour un surcoût acceptable (1 745 euros sur 3 ans)