

INTRODUCTION / OBJECTIFS :

Face à la gravité des chocs cardiorespiratoires liés à l'allergie au latex (2-3 par an au CHV), une démarche de bloc sans latex a été initiée depuis 1 an.

MATERIEL ET METHODES

- Extraction de la liste des DM (dispositifs médicaux) livrés aux blocs en 2012.
 - Analyse de la présence de latex : vérification des emballages et appels aux fournisseurs.
- Si présence de latex, recherche de DM de substitution LF (Latex free) et analyse financière.

RESULTATS

Sur 3936 DM, seuls 1.62% contiennent du latex (dont 1 uniquement dans le conditionnement primaire) (*graphique 1*) : gants, sondes de Foley, drain de Kehr, bande d'Esmarck... (*image 1,2,3*)
87.5% des DM avec latex présentent une mention sur l'emballage.

69% des DM avec latex sont substituables en LF, 31 % n'ont pas d'équivalent LF. (*graphique 2*)
Le surcoût estimé pour le remplacement des DM substituables s'élève à 45000€ TTC /an.




Graphique 1 : proportion de DM contenant du latex



Image 1 : sonde de Foley



Image 2 : drain de Kehr

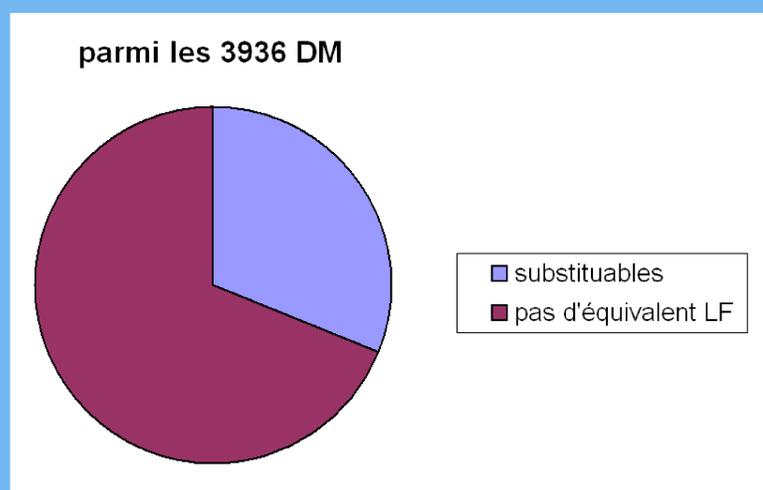

Graphique 2 : proportion de DM substituables



Image 3 : gants chirurgicaux

DISCUSSION

Problématique actuelle : Mise en place progressive du projet, initiée par le bloc Gynéco/Obstétrique (6 blocs), puis développée pour les autres blocs (14 blocs).

Difficultés rencontrées : obtention de la liste exhaustive des DM non stériles, changement des gants de chirurgiens, surcoût.

Problématique annexe : Détermination et mise en évidence des DM non substituables par des étiquettes fluo stipulant la présence de latex. Ces DM seront stockés dans une armoire identifiée « LATEX ».

Pour chaque nouveau DM, une analyse de la présence de latex doit être effectuée impliquant le personnel de bloc, de pharmacie et des services logistiques.

Un processus bloquant la livraison doit être mis en place lorsque que le statut du DM n'est pas connu.

CONCLUSION

Le projet « Bloc sans latex » est laborieux et chronophage mais bénéfique pour les patients. Il nécessite une vigilance régulière lors des nouveaux référencements

L'information « LF » sera à systématiser sur le cahier des charges de nos futurs appels d'offres.

La compensation du surcoût par la baisse du nombre de chocs allergiques devra être évaluée dans quelques années.