

Contexte / Objectif


Lors de la crise sanitaire COVID19, une forte demande en **système clos d'aspiration bronchique** a provoqué des **ruptures en cascade** chez les fournisseurs induisant de nombreux approvisionnements et une multiplicité de références avec des caractéristiques techniques **divergentes**.

Objectif : Assurer le bon usage des dispositifs médicaux (DM) dans tous les services utilisateurs (*utilisateurs habituels ou non*) malgré un contexte de prise en charge des patients complexe.

Matériel et méthodes

- Solliciter les fournisseurs commercialisant des systèmes clos d'aspiration bronchique sur le marché
- Analyser la documentation technique, identifier les divergences et organiser les substitutions avec chaque référence disponible

Résultats / Discussion

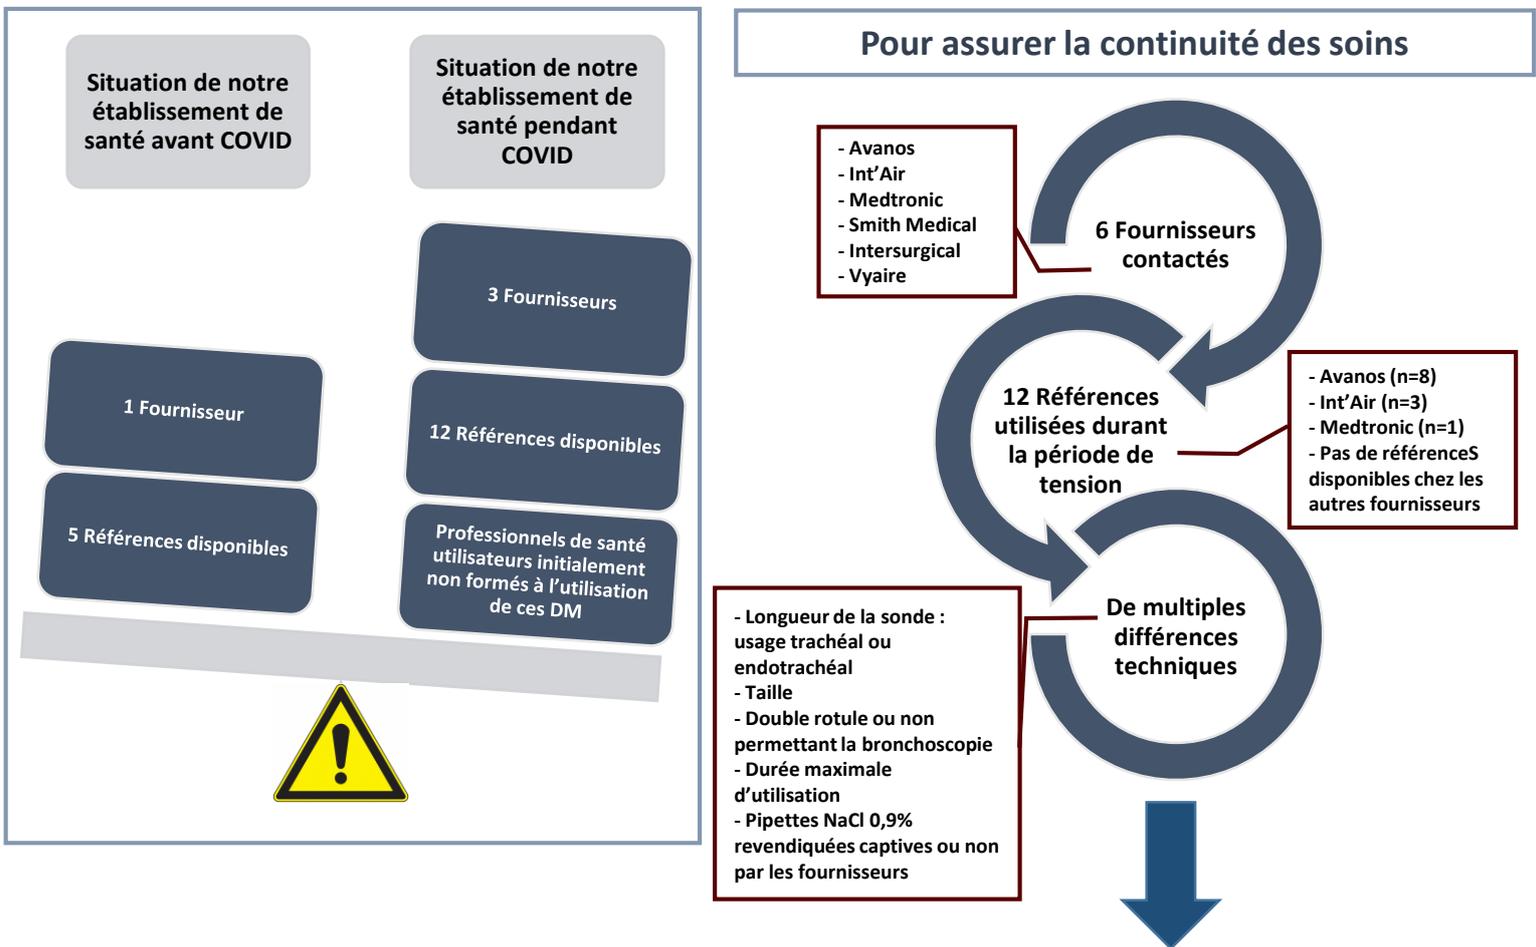

PRIMORDIAL D'INFORMER LES SERVICES UTILISATEURS DES DIVERGENCES ENTRE LES RÉFÉRENCES ET D'ASSURER LA SÉCURITÉ DE LEUR UTILISATION

→ **Intégration des informations techniques dans les libellés produits**



→ **Diffusion d'outils pédagogiques : note information et vidéo**



Conclusion

Certaines situations peuvent engendrer la multiplicité de fournisseurs et de références pour un même besoin. Outre le fait de pallier les tensions d'approvisionnements, il est important **d'identifier** et de **communiquer** aux services utilisateurs les différences entre ces références pour **assurer la continuité des soins et le bon usage**.