

# Retrait de lot de perfuseurs captifs d'un parc de pompes volumétriques : N°90 quelle stratégie adopter ?


AS.MARTIN<sup>1</sup>, E.NAMUR<sup>1</sup>, D.FAYARD<sup>2</sup>, E.ORNG<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pharmacie à usage intérieur, <sup>2</sup>Service biomédical, Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild (Paris 19<sup>e</sup>)

contact : [annesophiemartin95@gmail.com](mailto:annesophiemartin95@gmail.com)

Mots clés: matériovigilance, gestion, audit, rupture


Tous les services de l'hôpital sont équipés de **pompes volumétriques (PV)** d'une société qui fournit également les perfuseurs captifs.

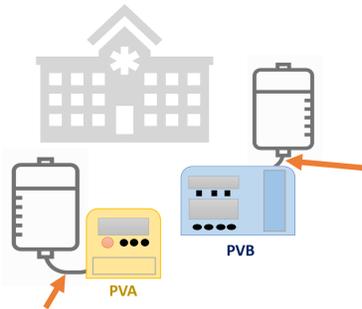



➔ Un **retrait de lot** de tous les perfuseurs nous a conduits à mener une stratégie alternative rapide.



## MATERIEL & METHODES

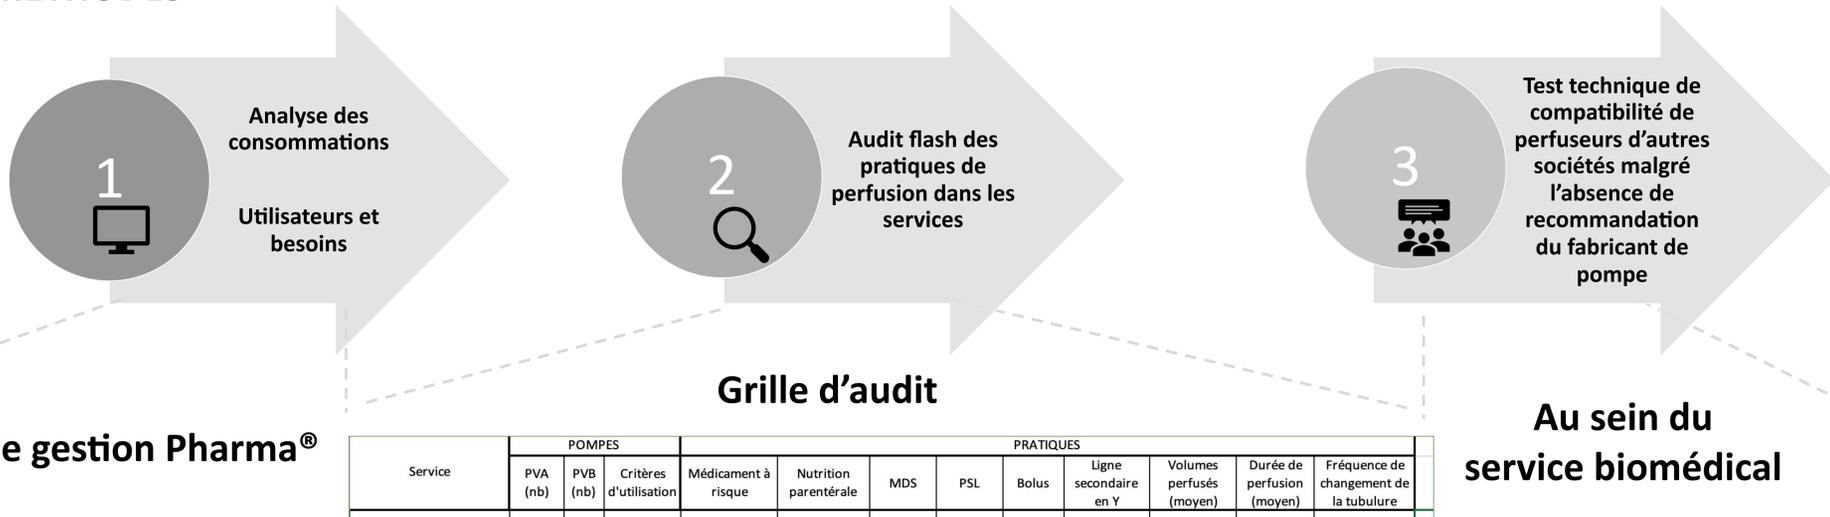

## RESULTATS

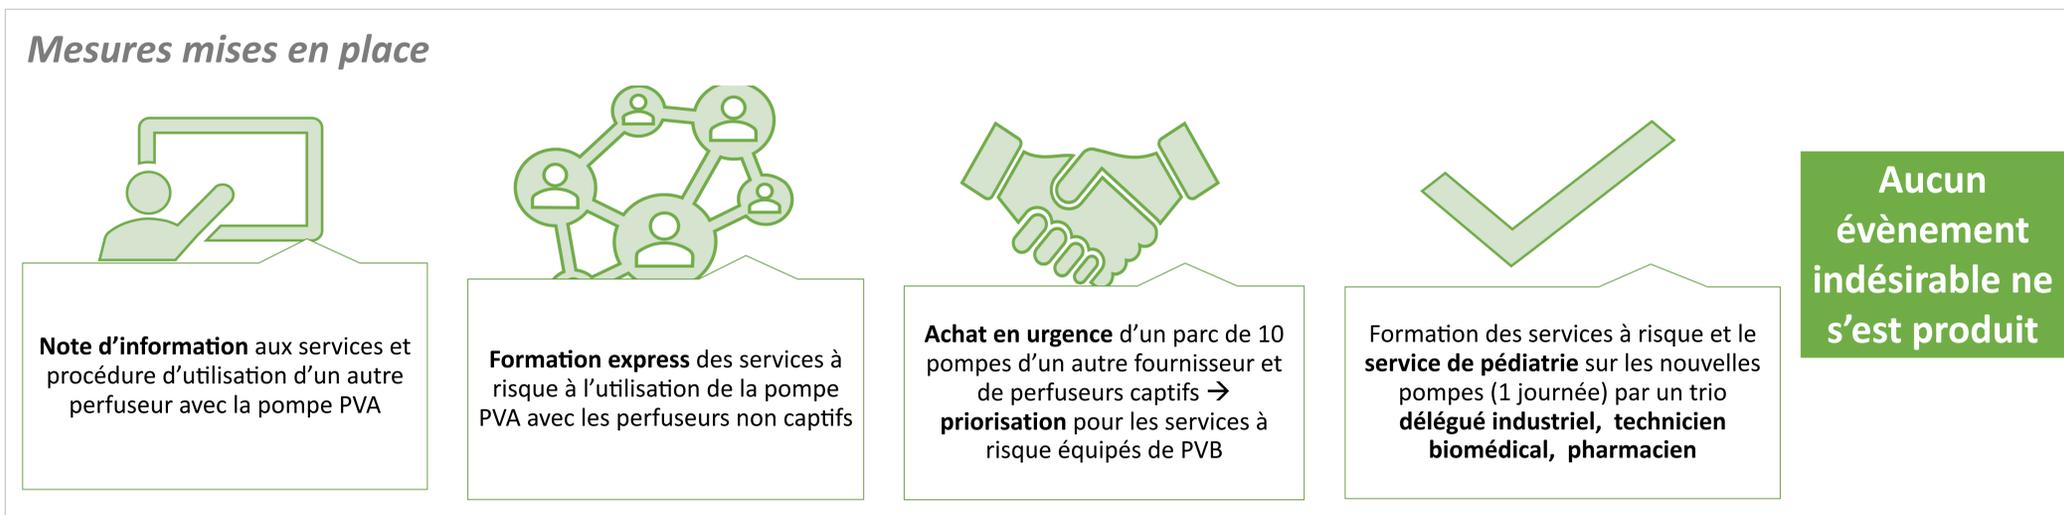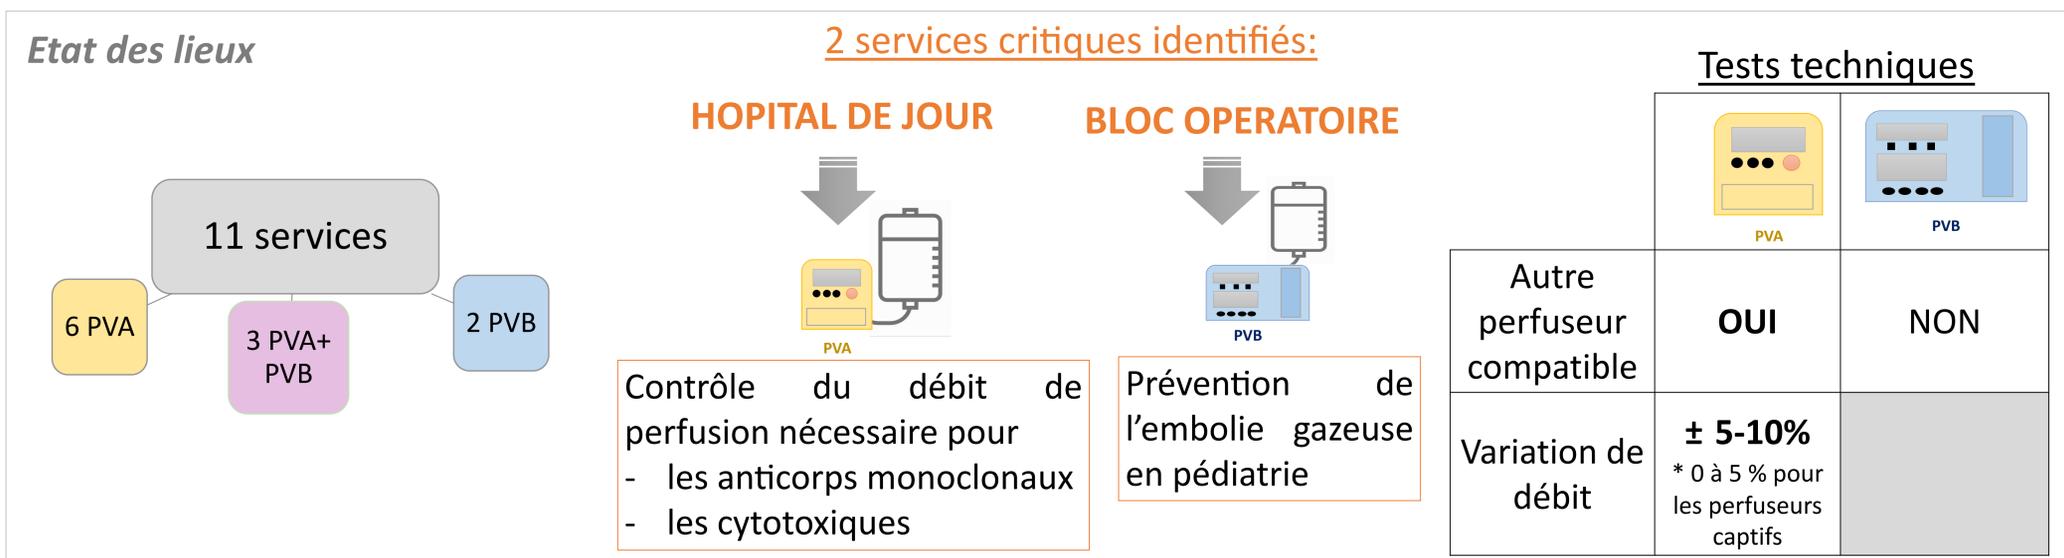

## DISCUSSION - CONCLUSION

