


En septembre 2019, l'ANSM a émis de nouvelles recommandations de photoprotection pour l'administration de tels produits.

Évaluation du coût

Tableau 2. Résultats de l'évaluation du coût du montage non opaque *versus* montage opaque (= photoprotecteur). [PU = prix unitaire ; HT = hors taxes]

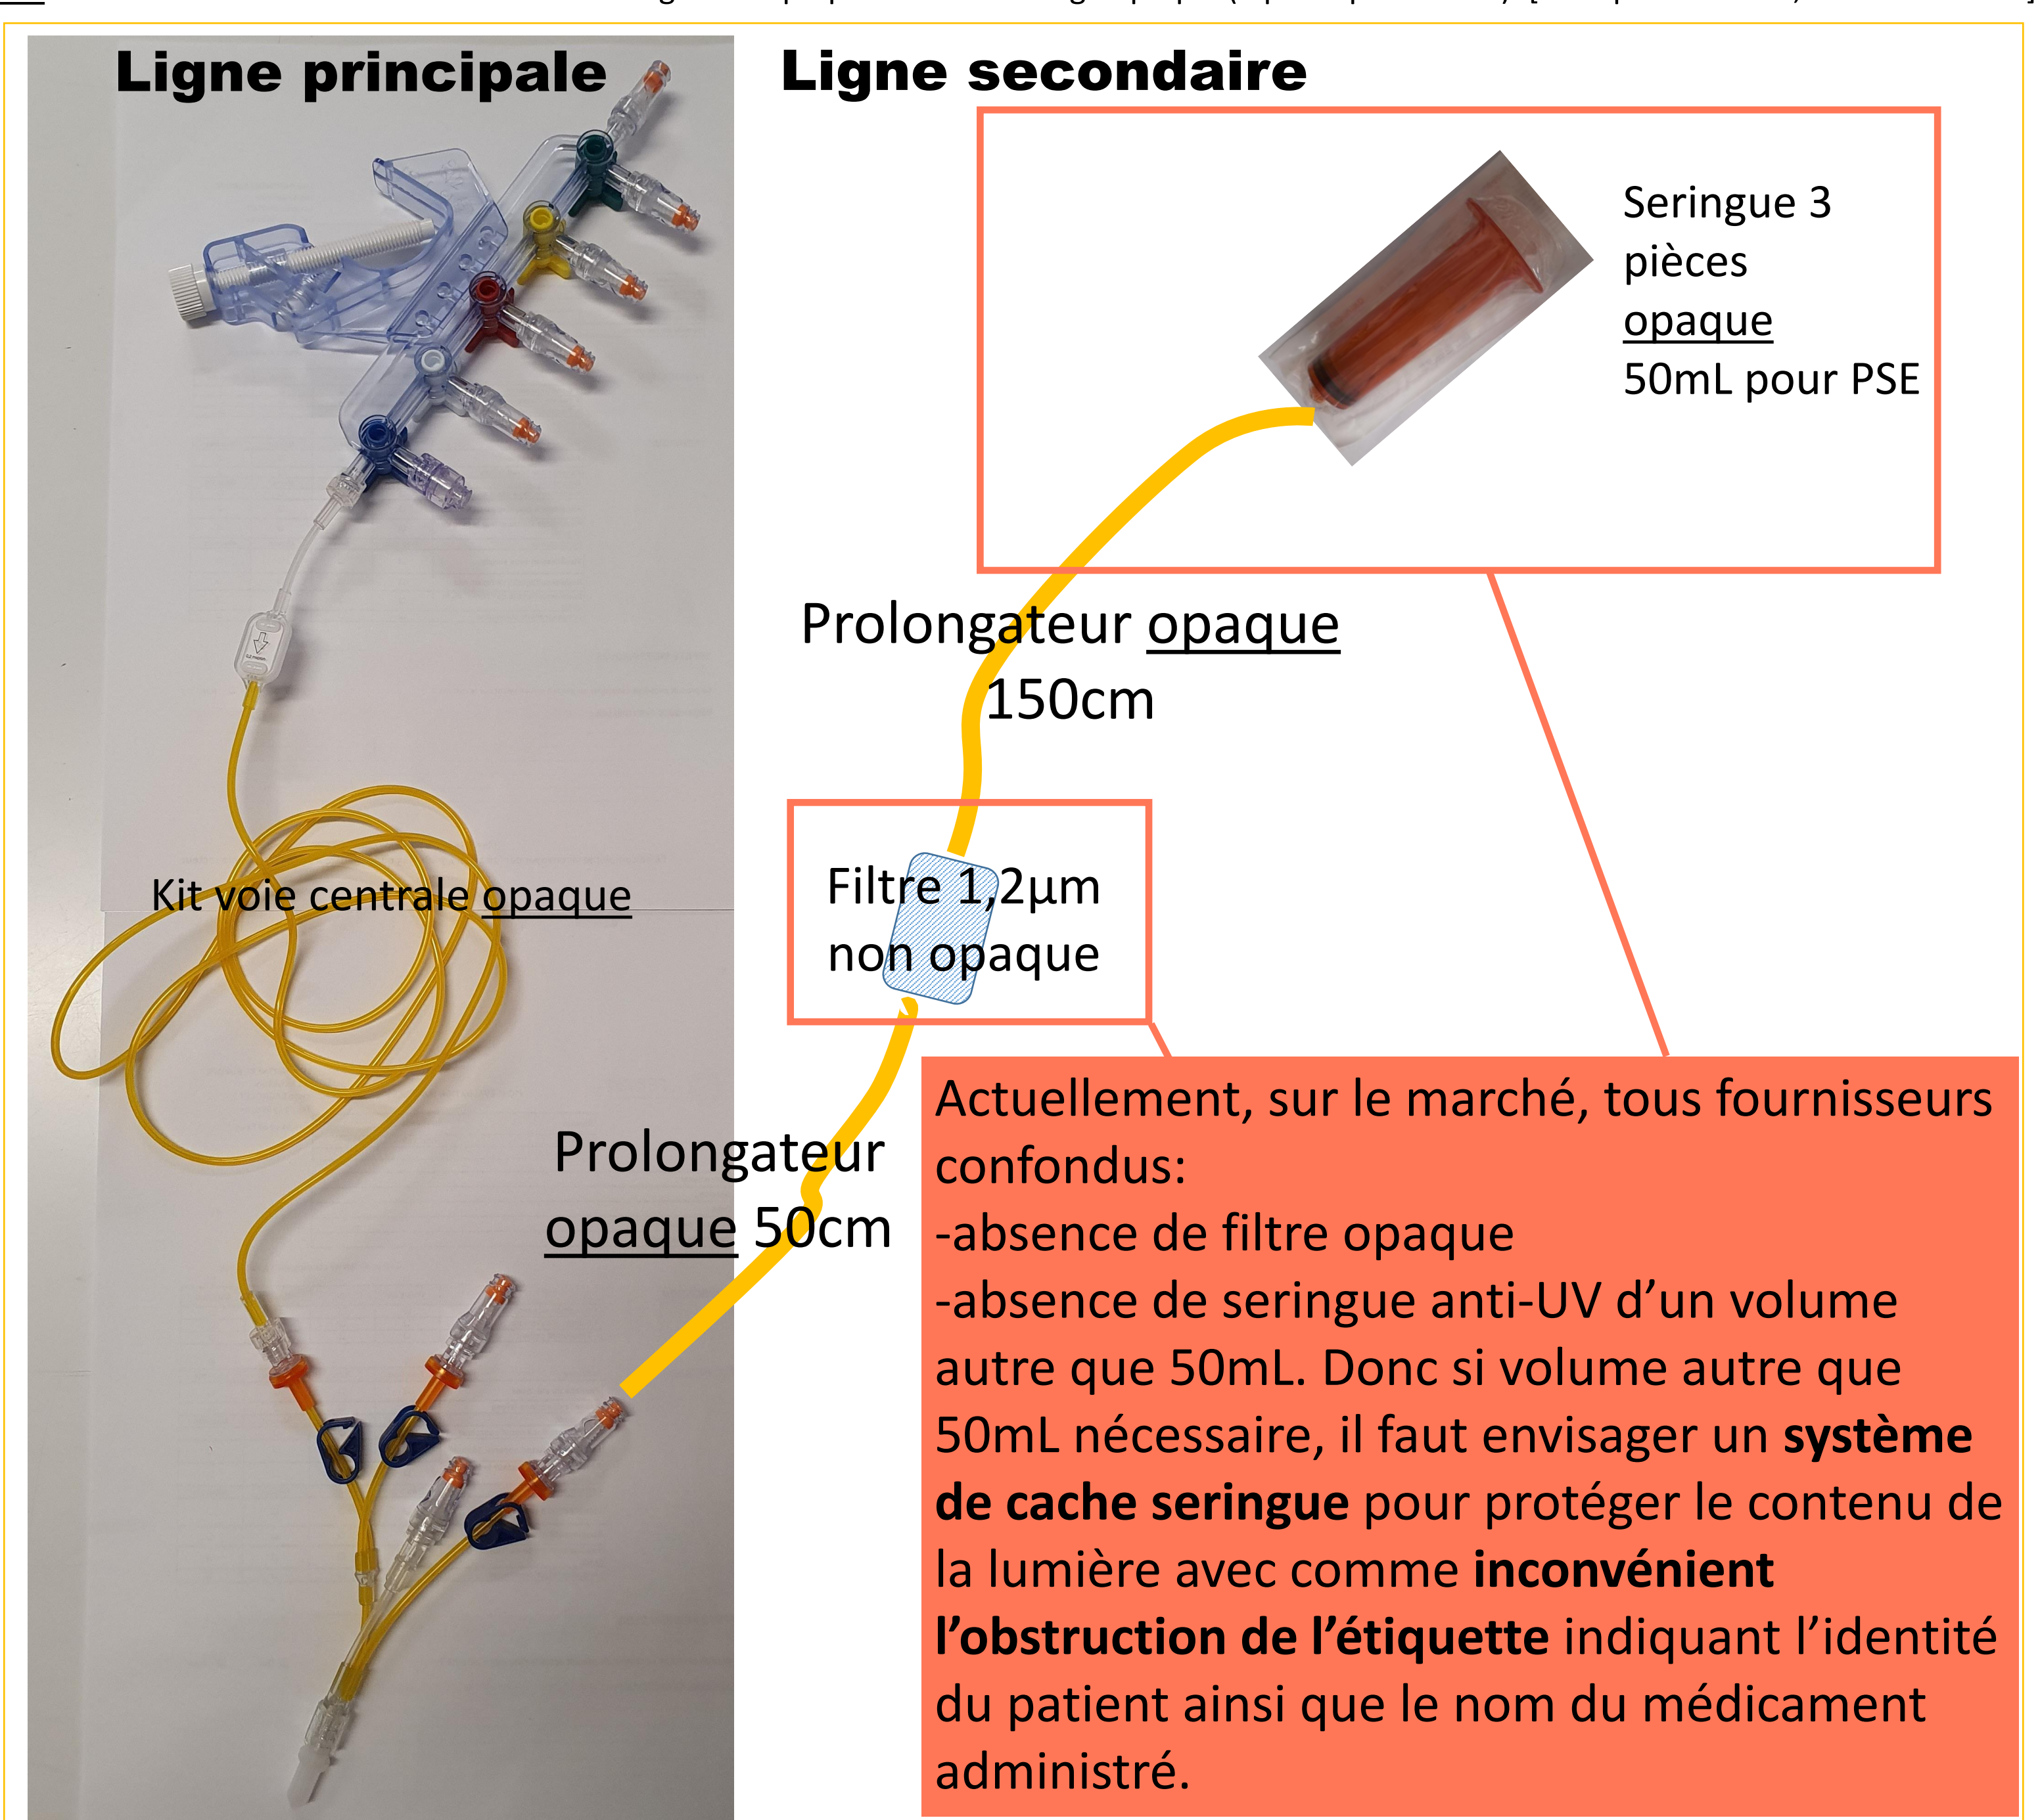

Il est constaté que la photoprotection des lignes de perfusion est relativement simple à mettre en place mais avec un léger **surcoût à envisager**. Nous travaillons avec les fournisseurs pour envisager un prolongateur de 200cm avec filtre 1,2µm monté pour limiter le nombre de manipulations dans le service.