


Introduction:



- Articles R5212-36 à 42 du CSP
- Décret 2000-1316
- Le règlement EU 2017/745
- Arrêté du 8 septembre 2021
- Audit de l'OMEDIT Grand Est (remise du document de traçabilité au patient)

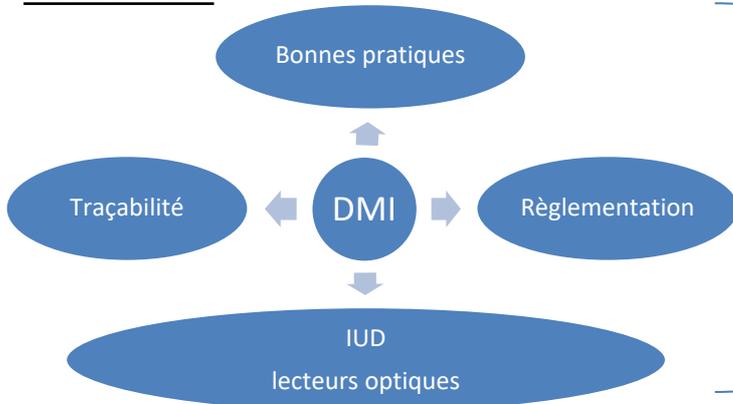

Objectif : Dresser un état des lieux du circuit des DMI et mettre en place des actions d'amélioration le cas échéant.



Matériel et Méthode:

- Autodiagnostic du circuit des DMI fourni par l'ANAP (Inter Diag DMS DMI module US 2021)
- Inventaire des DMI à la PUI et au bloc opératoire



Résultats:

1) Taux de conformité:

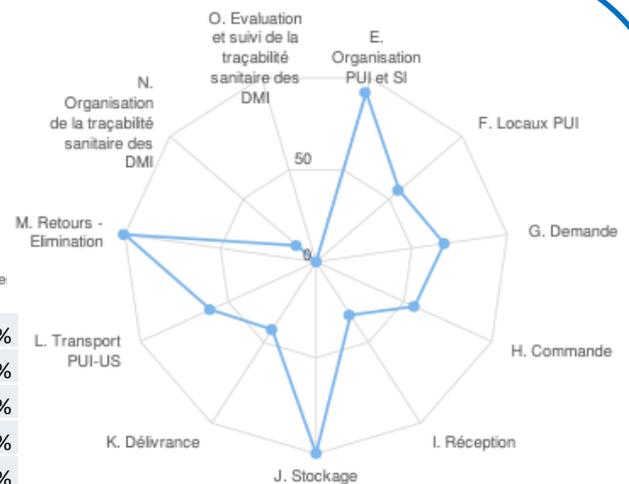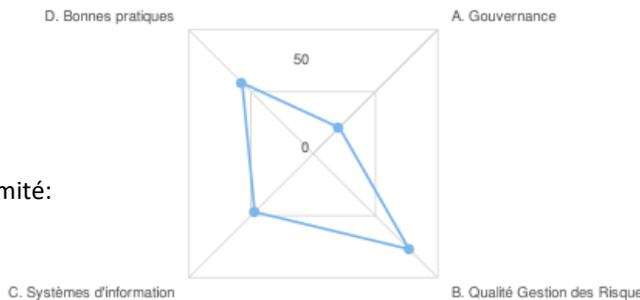

| | | | |
|---------------------------------|------|---|-----|
| Stockage (J) | 100% | Commande (H) | 56% |
| Retours-Elimination (M) | 100% | Système d'information (C) | 47% |
| Organisation PUI et SI (E) | 92% | Délivrance (K) | 42% |
| Qualité Gestion des Risques (B) | 77% | Réception (I) | 33% |
| Demande (G) | 67% | Gouvernance (A) | 21% |
| Transport PUI-US (L) | 60% | Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI (N) | 13% |
| Locaux PUI (F) | 57% | Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI (O) | 0% |
| Bonnes pratiques (D) | 57% | | |



2) Inventaire:

884 traçabilités de DMI manquantes: 71% de DMI d'orthopédie (le ciment en particulier), 18% de DMI digestifs et 10% les chambres implantables.

Plusieurs erreurs de réception : 15 d'erreurs de saisie de lots et 1 d'erreur de références



3) Actions correctives mises en place:

- Nouvelle version de PHARMA pour intégrer le système de l'IUD
- Achat de lecteurs optiques (lecture des codes à 1D et à 2D)
- Long travail de paramétrage des logiciels et de correction des données existantes
- Révision du système de qualité et nomination d'un Responsable du Système de Management de la Qualité
- Formations des agents (Pharmaciens, Préparateurs, magasiniers, IBODE...)
- Utilisation des codes barres et des lecteurs optiques à toute les étapes du circuit des DMI



Discussion/Conclusion: L'évaluation a mis en avant une faiblesse au niveau de la traçabilité de notre circuit DMI. Les actions mises en place modifient l'organisation actuelle et aboutissent à la traçabilité en temps réel sur notre logiciel de gestion PHARMA par les IBODE avec incrémentation de la feuille de pose dans notre dossier patient informatisé. Les lecteurs optiques et l'utilisation de l'IUD permettent la sécurisation de la saisie des données ainsi qu'un gain de temps considérable.