NRFIT : RETOUR SUR LE DÉPLOIEMENT, UN AN APRÈS

L. SZKUDLARA, S. POMIES, D. PECANI
CHU de Toulouse

n°91

10, 11 et 12 octobre 2023

Thème : Pharmacie clinique - Evaluation

Mots clés : Anesthésie, Sécurisation, Connectique

szkudlara.lea@gmail.com

INTRODUCTION

DECEMBRE 2021

Déploiement de la connectique NRFit pour les DM d'anesthésie loco-régionale (ALR)

Service Maternité et Gynéco-obstétrique

Paule de Viguier – CHU Toulouse

JANVIER 2023

EVALUATION POST-DEPLOIEMENT :

- Impact financier réel de la connectique
- Evolution déclarations d'erreurs d'administration
- Retours des soignants sur le déploiement

MATERIEL ET METHODES

Impact financier

- Analyse quantités/coûts DM ALR LL sur 2021 DM ALR NRFit sur 2022
- Comparaison coût par procédure : LL *vs* NRFit

Erreurs d'administration

- Extraction déclarations d'EI par erreur de voie d'administration, en lien avec l'ALR

Questionnaire

- Recueil du ressenti des utilisateurs sur le déploiement du NRFit
- Recueil du ressenti des utilisateurs sur l'utilisation du NRFit

+ Extraction du **relevé d'activité du service** par l'intermédiaire du Département d'Information Médicale (DIM)

RESULTATS

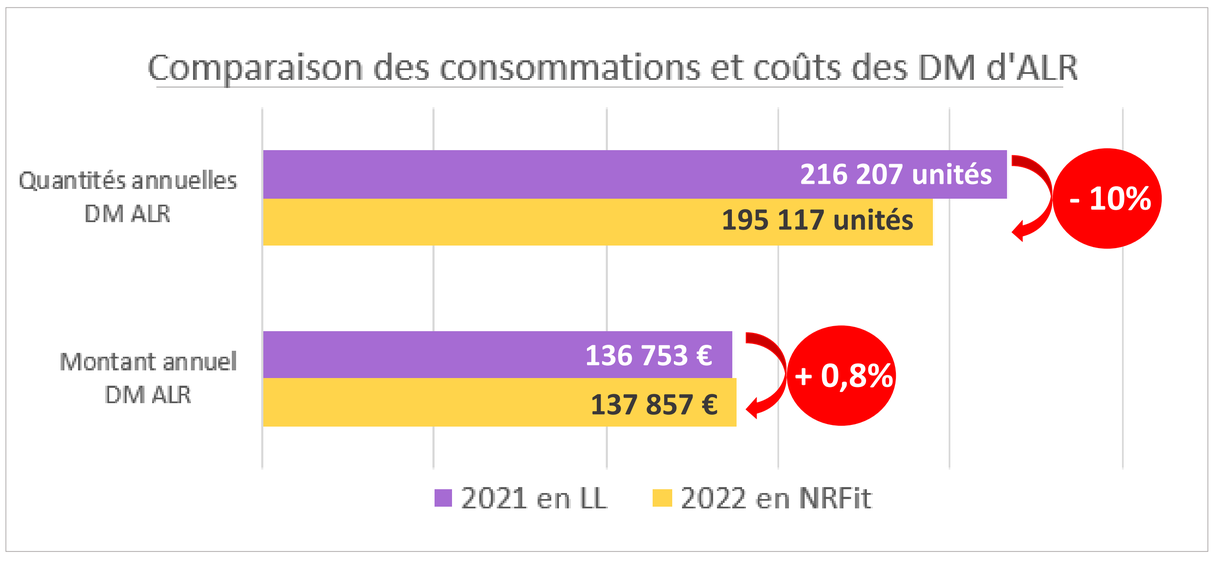

Questionnaire à destination des soignants : **12 réponses**, dont :

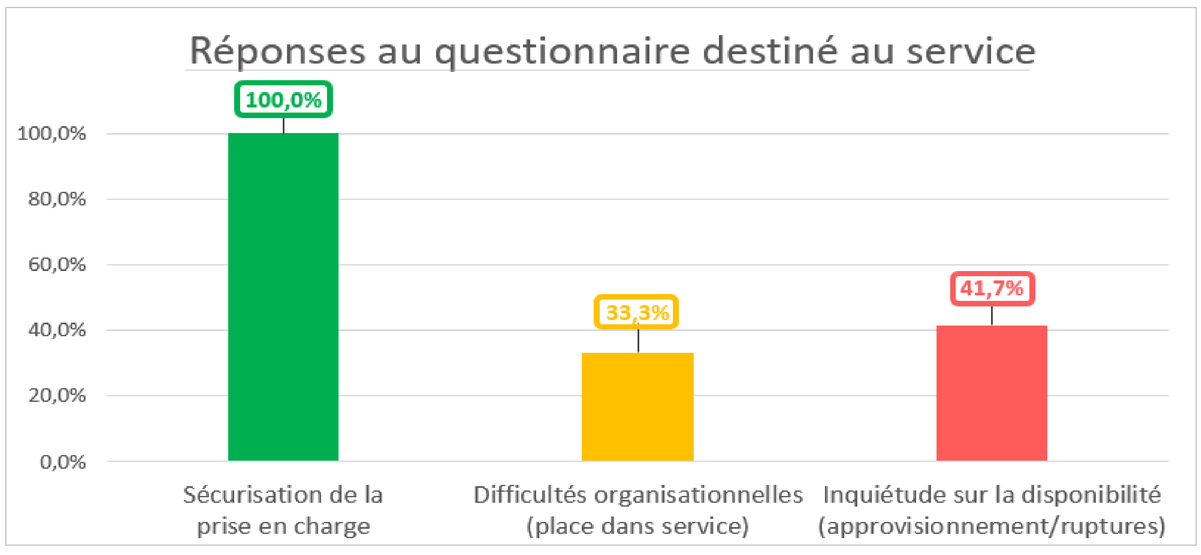

- Coût par procédure : Impact du passage au NRFit
  Péridurale → +26% ; **Rachianesthésie continue → +41%** ; **Péri-rachianesthésie combinée → +2%**

- Activité du service : 4229 actes d'ALR enregistrés en 2021, et 4240 actes d'ALR en 2022 dans le service → **+0,2% d'activité**

- Evènements indésirables : Aucune déclaration d'EI par erreur de voie d'administration n'a été enregistrée à ce jour depuis le déploiement du NRFit, contre 4 sur les 6 dernières années avant le déploiement → **Surveillance des déclarations**

DISCUSSION ET CONCLUSION

La préparation du déploiement du NRFit a permis une révision des pratiques et procédures d'ALR par un **travail multidisciplinaire**.

La **rationalisation des références** a été à l'origine d'une diminution des consommations en quantité, avec des dotations ramenées aux justes quantités, dans une démarche éco-responsable. Cette révision de pratique et des dotations a également permis l'**absorption du surcoût *a priori*** (dû à l'augmentation du coût par procédure) de cette nouvelle connectique, pour une activité de service stable.

Les équipes soignantes sont **satisfaites de cette connectique et de son déploiement**, et nous ont fait remonter leurs **craintes organisationnelles** et concernant de **potentielles difficultés d'approvisionnement**. Des **axes d'amélioration** ont été proposés par les équipes soignantes pour le déploiement à venir de la connectique NRFit dans les autres services du CHU de Toulouse.

33èmes JNFDM Clermont-Ferrand