

NRFIT est déployée : en êtes-vous satisfait ?

(1)Dubray Q., (2)Untereiner O., (1)Gohari A., (1)Bezian E.

(1)Département de Pharmacie, (2)Département d'Anesthésie

Institut Mutualiste Montsouris, 42 boulevard Jourdan, 75014 Paris – e-mail : quentin.dubray@imm.fr

Mots clefs : Neuraxiale, connectique, sécurisation, retour d'expérience

L'INSTITUT
MUTUALISTE
MONTSOURIS



1 Introduction / Objectifs

Le 17 mai 2022, nous déployons la **connectique NRFIT**, issue de la norme ISO 80369-6, afin de sécuriser les voies d'administration neuraxiale et péridurale au sein de notre établissement de santé (ES). Ce système de prévention passif est un bénéfice indéniable pour la **sécurisation de la prise en charge des patients**. A un an de ce déploiement, nous souhaitons **recueillir l'appréciation** de l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux.


2 Matériel & Méthodes

Une enquête de satisfaction est adressée aux personnels médicaux et paramédicaux concernés.

Elle se compose de **6 questions fermées** :

- ✓ Fonction
- ✓ Connaissance de la norme NRFIT
- ✓ Satisfaction de la communication pré-déploiement
- ✓ Satisfaction des modalités de déploiement sur une journée unique
- ✓ Satisfaction de la documentation qualité associée
- ✓ Modification des pratiques post-déploiement

Deux questions ouvertes : évolutions souhaitées au sein du référentiel NRFIT actuel et un commentaire libre.

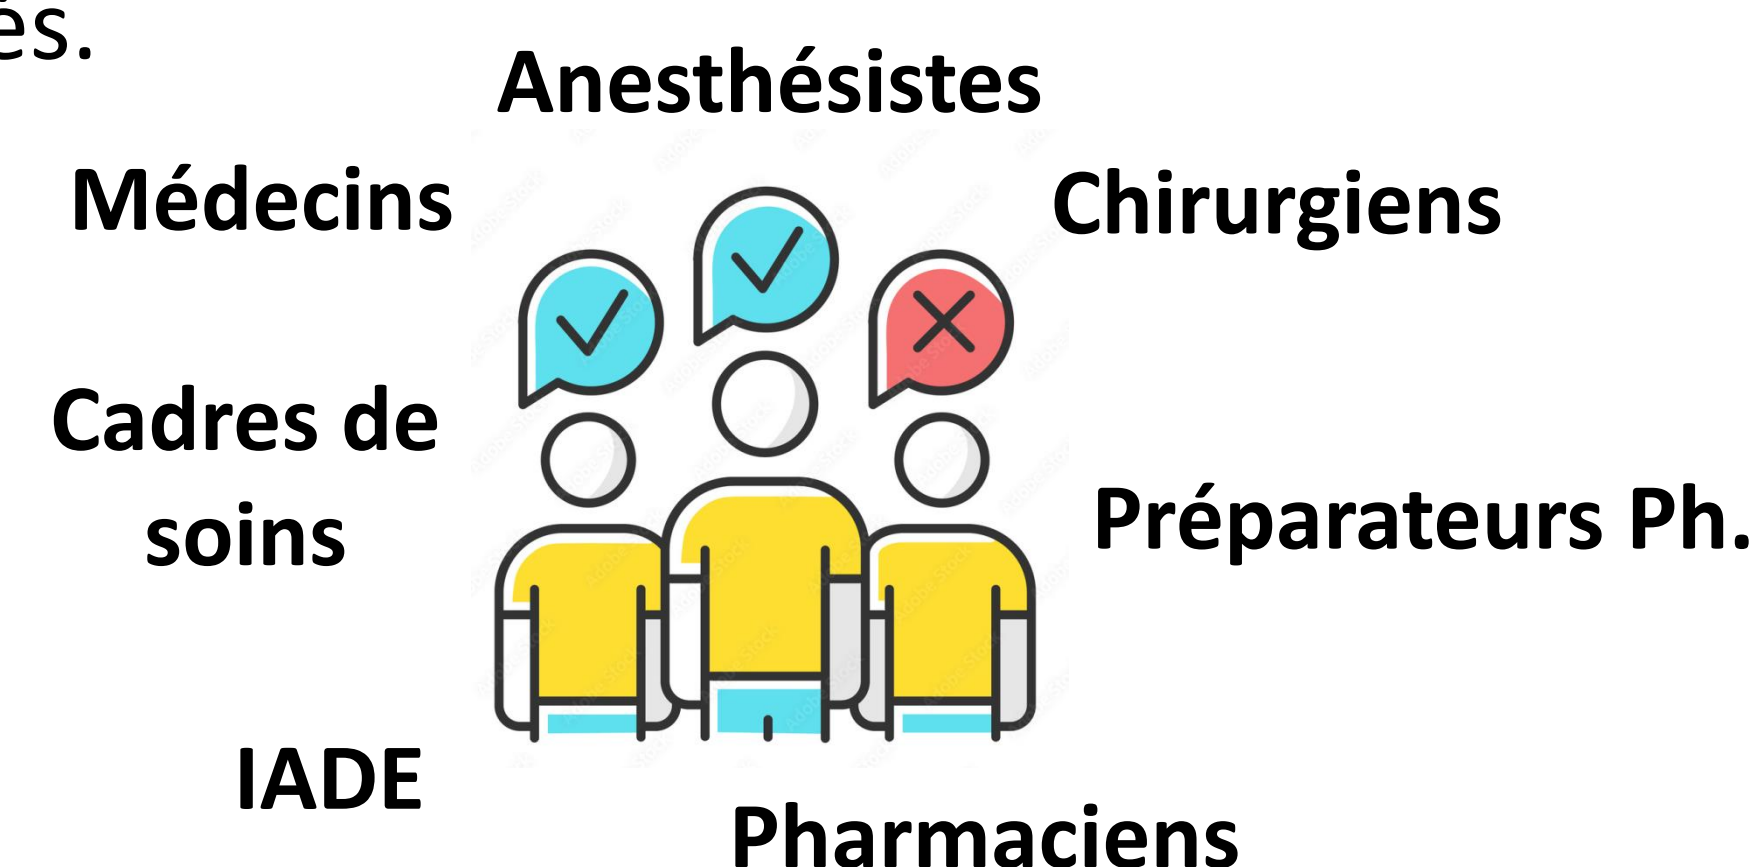

3 Résultats

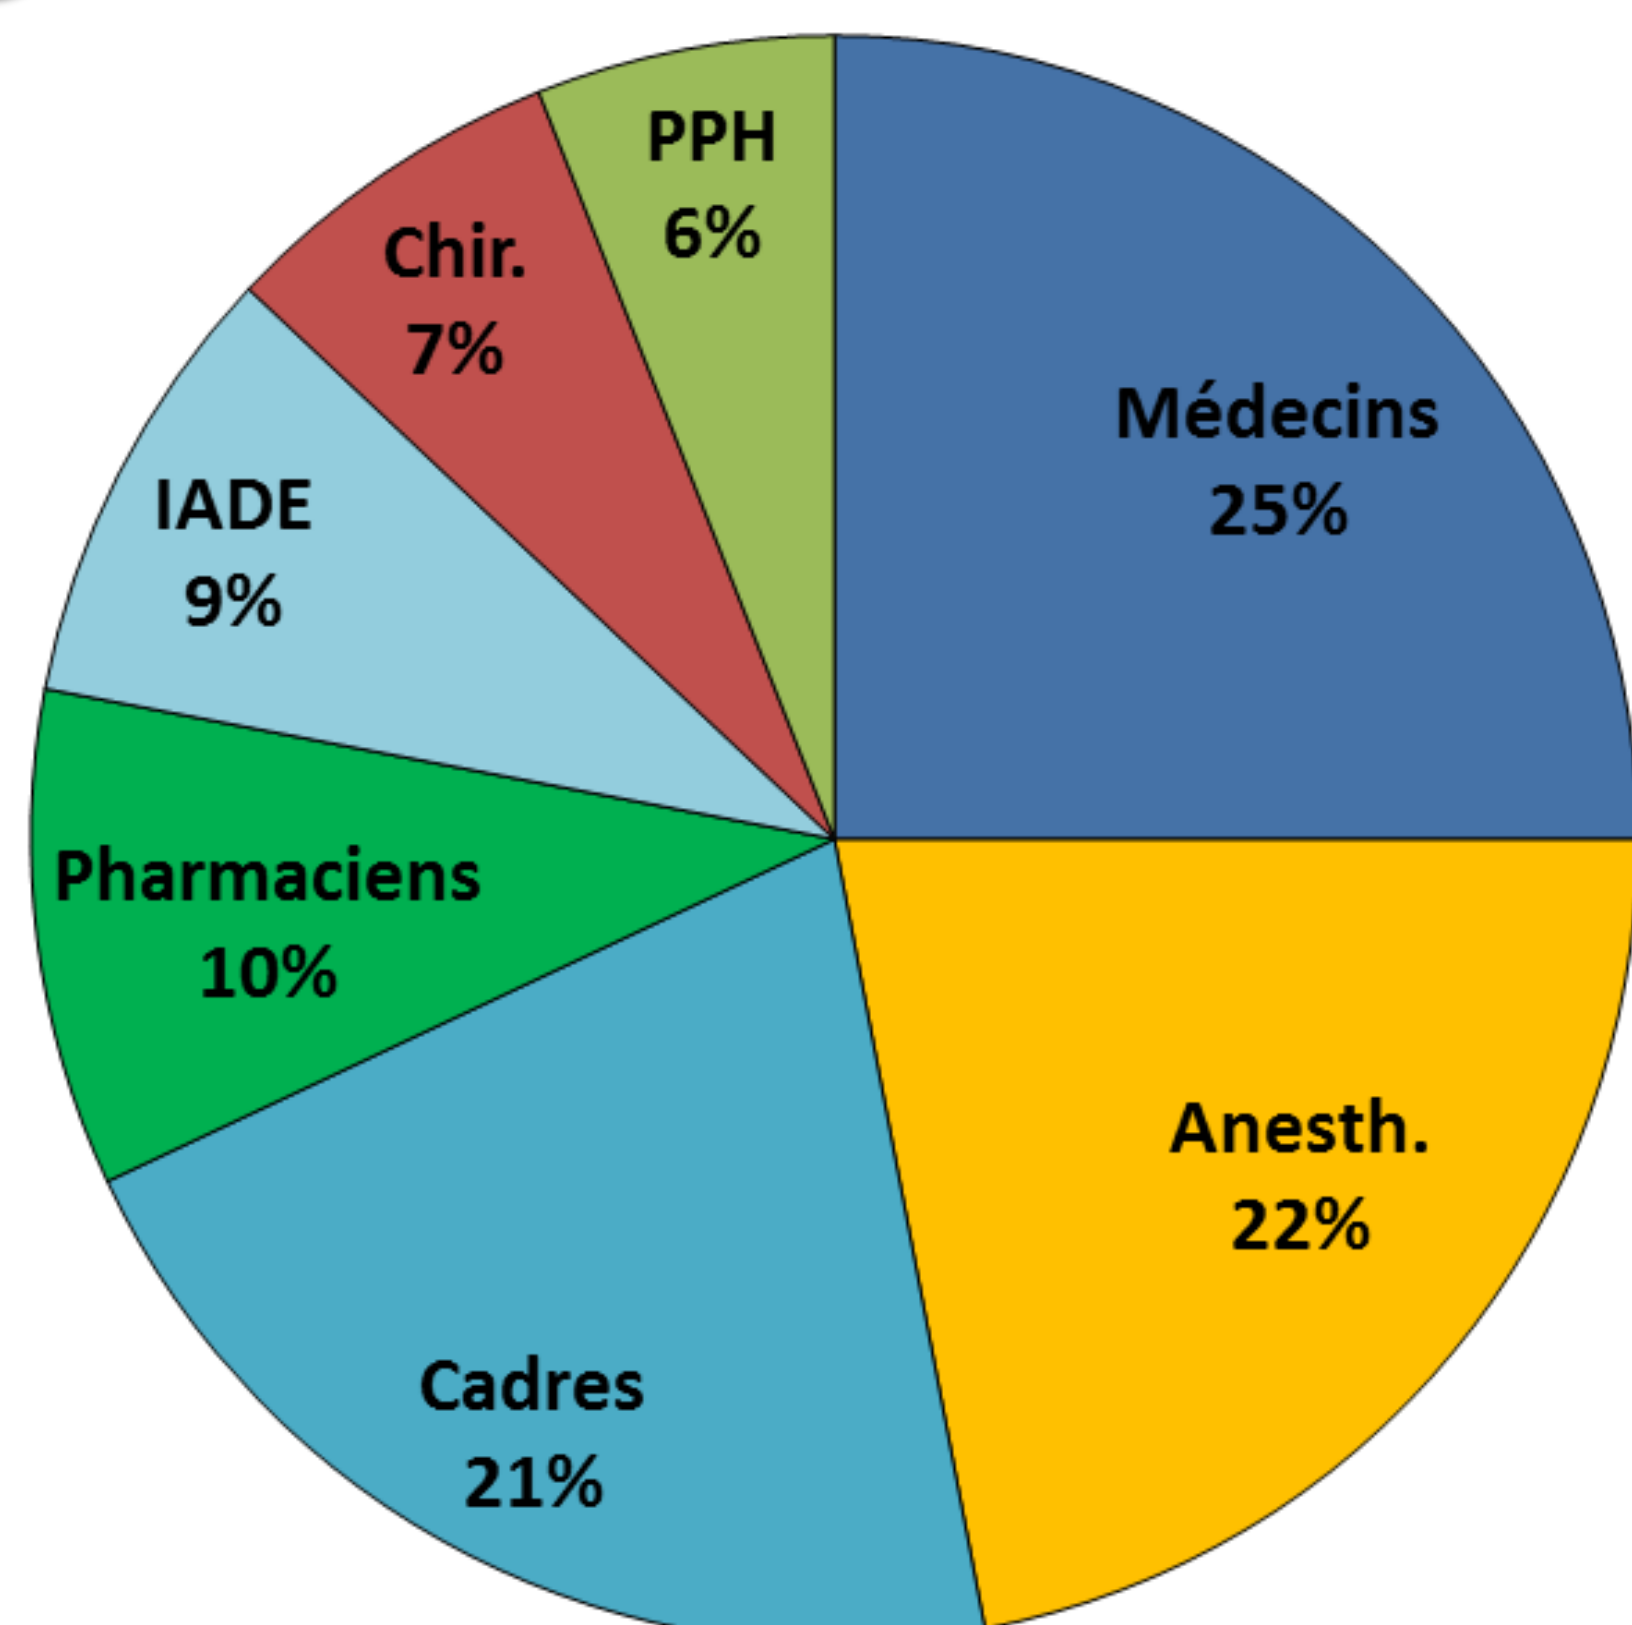


Fig. 1 – Fonction des répondants (n = 68)

Connaissance de l'objectif de la norme NRFIT

Satisfaction de la communication pré-déploiement

Satisfaction des modalités de déploiement sur une journée unique

Satisfaction de la documentation qualité associée

Modification des pratiques post-déploiement


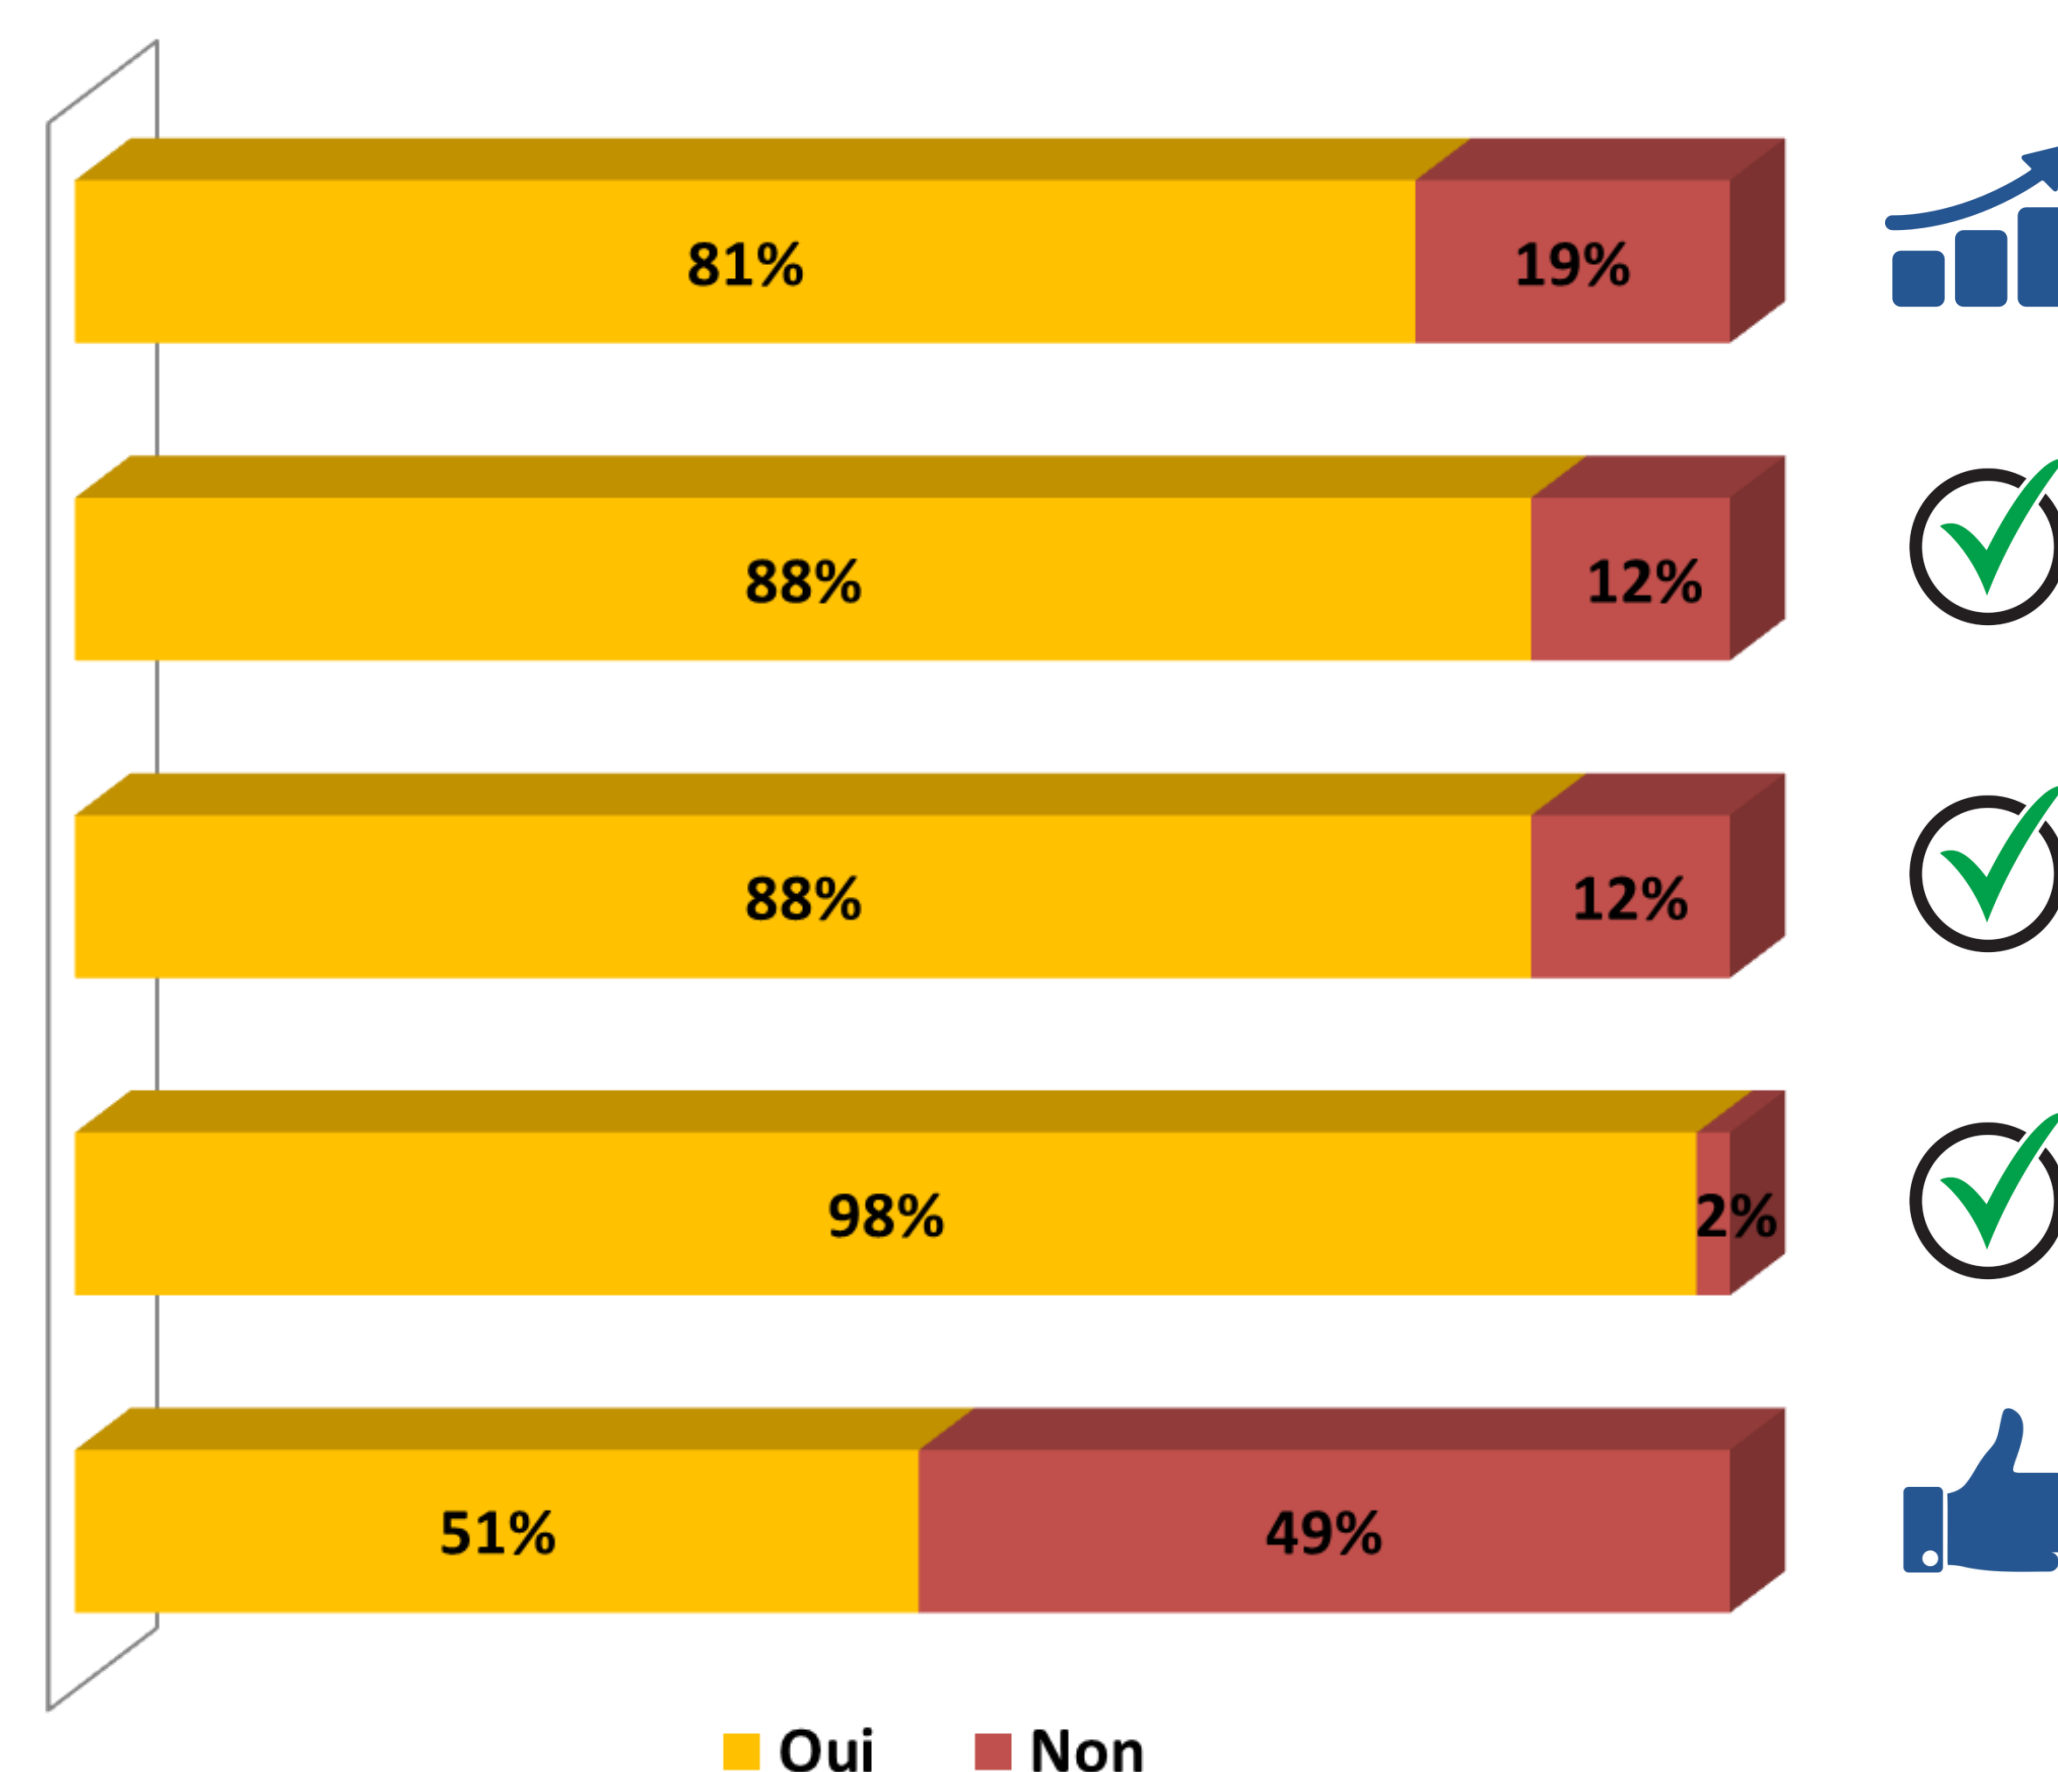


Fig. 2 – Résultats des questions fermées de l'enquête



Quelles évolutions souhaitez-vous au sein du référentiel NRFIT actuel ?

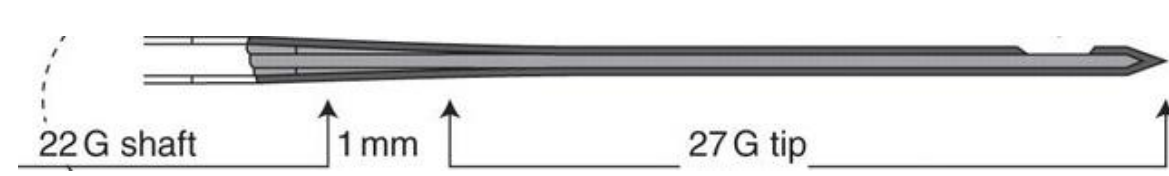

Aiguilles de rachianesthésie 22/27G NRFIT



Aiguilles de Huber NRFIT pour chambre intrathécale



Connecteurs Spike NRFIT pour la préparation des chimiothérapies IT



Commentaires libres :

NRFIT Amélioration de l'étiquetage du stockage dans un poste de soin



Renforcer la formation pré-déploiement



Impossibilité de transférer des patients avec un cathéter NRFIT vers un ES non équipé de DM à connectique NRFIT

4 Discussion / Conclusion

La mise en place de la norme NRFIT est une **réussite** pour notre ES. Les équipes médicales et paramédicales concernées se sont impliquées dans le projet afin que cette transition soit optimale. Néanmoins, cette enquête démontre que la norme NRFIT **n'est pas encore connue de tous**. Les **retours positifs** sur le déploiement nous confortent sur la stratégie définie. La modification des pratiques est **transparente** pour nos équipes. Elle est liée au changement du DM utilisé et non à la modification du geste. Les **souhaits d'évolutions du référentiel** de DM NRFIT exprimés par les utilisateurs appuient les **sollicitations régulières** du groupe de travail auprès des industriels.