

ETAT DES LIEUX DES RUPTURES DE DISPOSITIFS MEDICAUX DANS UN CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Poster n°6



RETHO E.¹ ; BOURGEOIS A-L.¹ ; GIRAULT C.¹ ; FERRAND A-L.¹ ; PECANI D.¹

1 : Logipharma - service pharmacie, CHU Toulouse



INTRODUCTION

Au quotidien, le temps consacré à la gestion des ruptures d'approvisionnement de dispositifs médicaux (DM) est de plus en plus important


→ Nous avons souhaité réaliser un état des lieux des ruptures de DM dans notre établissement de santé

MATERIEL ET METHODES


- **Novembre 2015 : mise en place d'un tableau de suivi des ruptures**
- A chaque nouvelle rupture, nous renseignons dans ce tableau :
 - ✓ la référence en rupture et celle validée comme alternative si existante
 - ✓ la date de début de rupture
 - ✓ la date de fin initialement annoncée par le fournisseur et celle finalement effective
- Six mois après l'instauration de cet outil informatique, une analyse quantitative et descriptive des données a été réalisée

RESULTATS

→ En 6 mois, 105 références de DM ont été en rupture

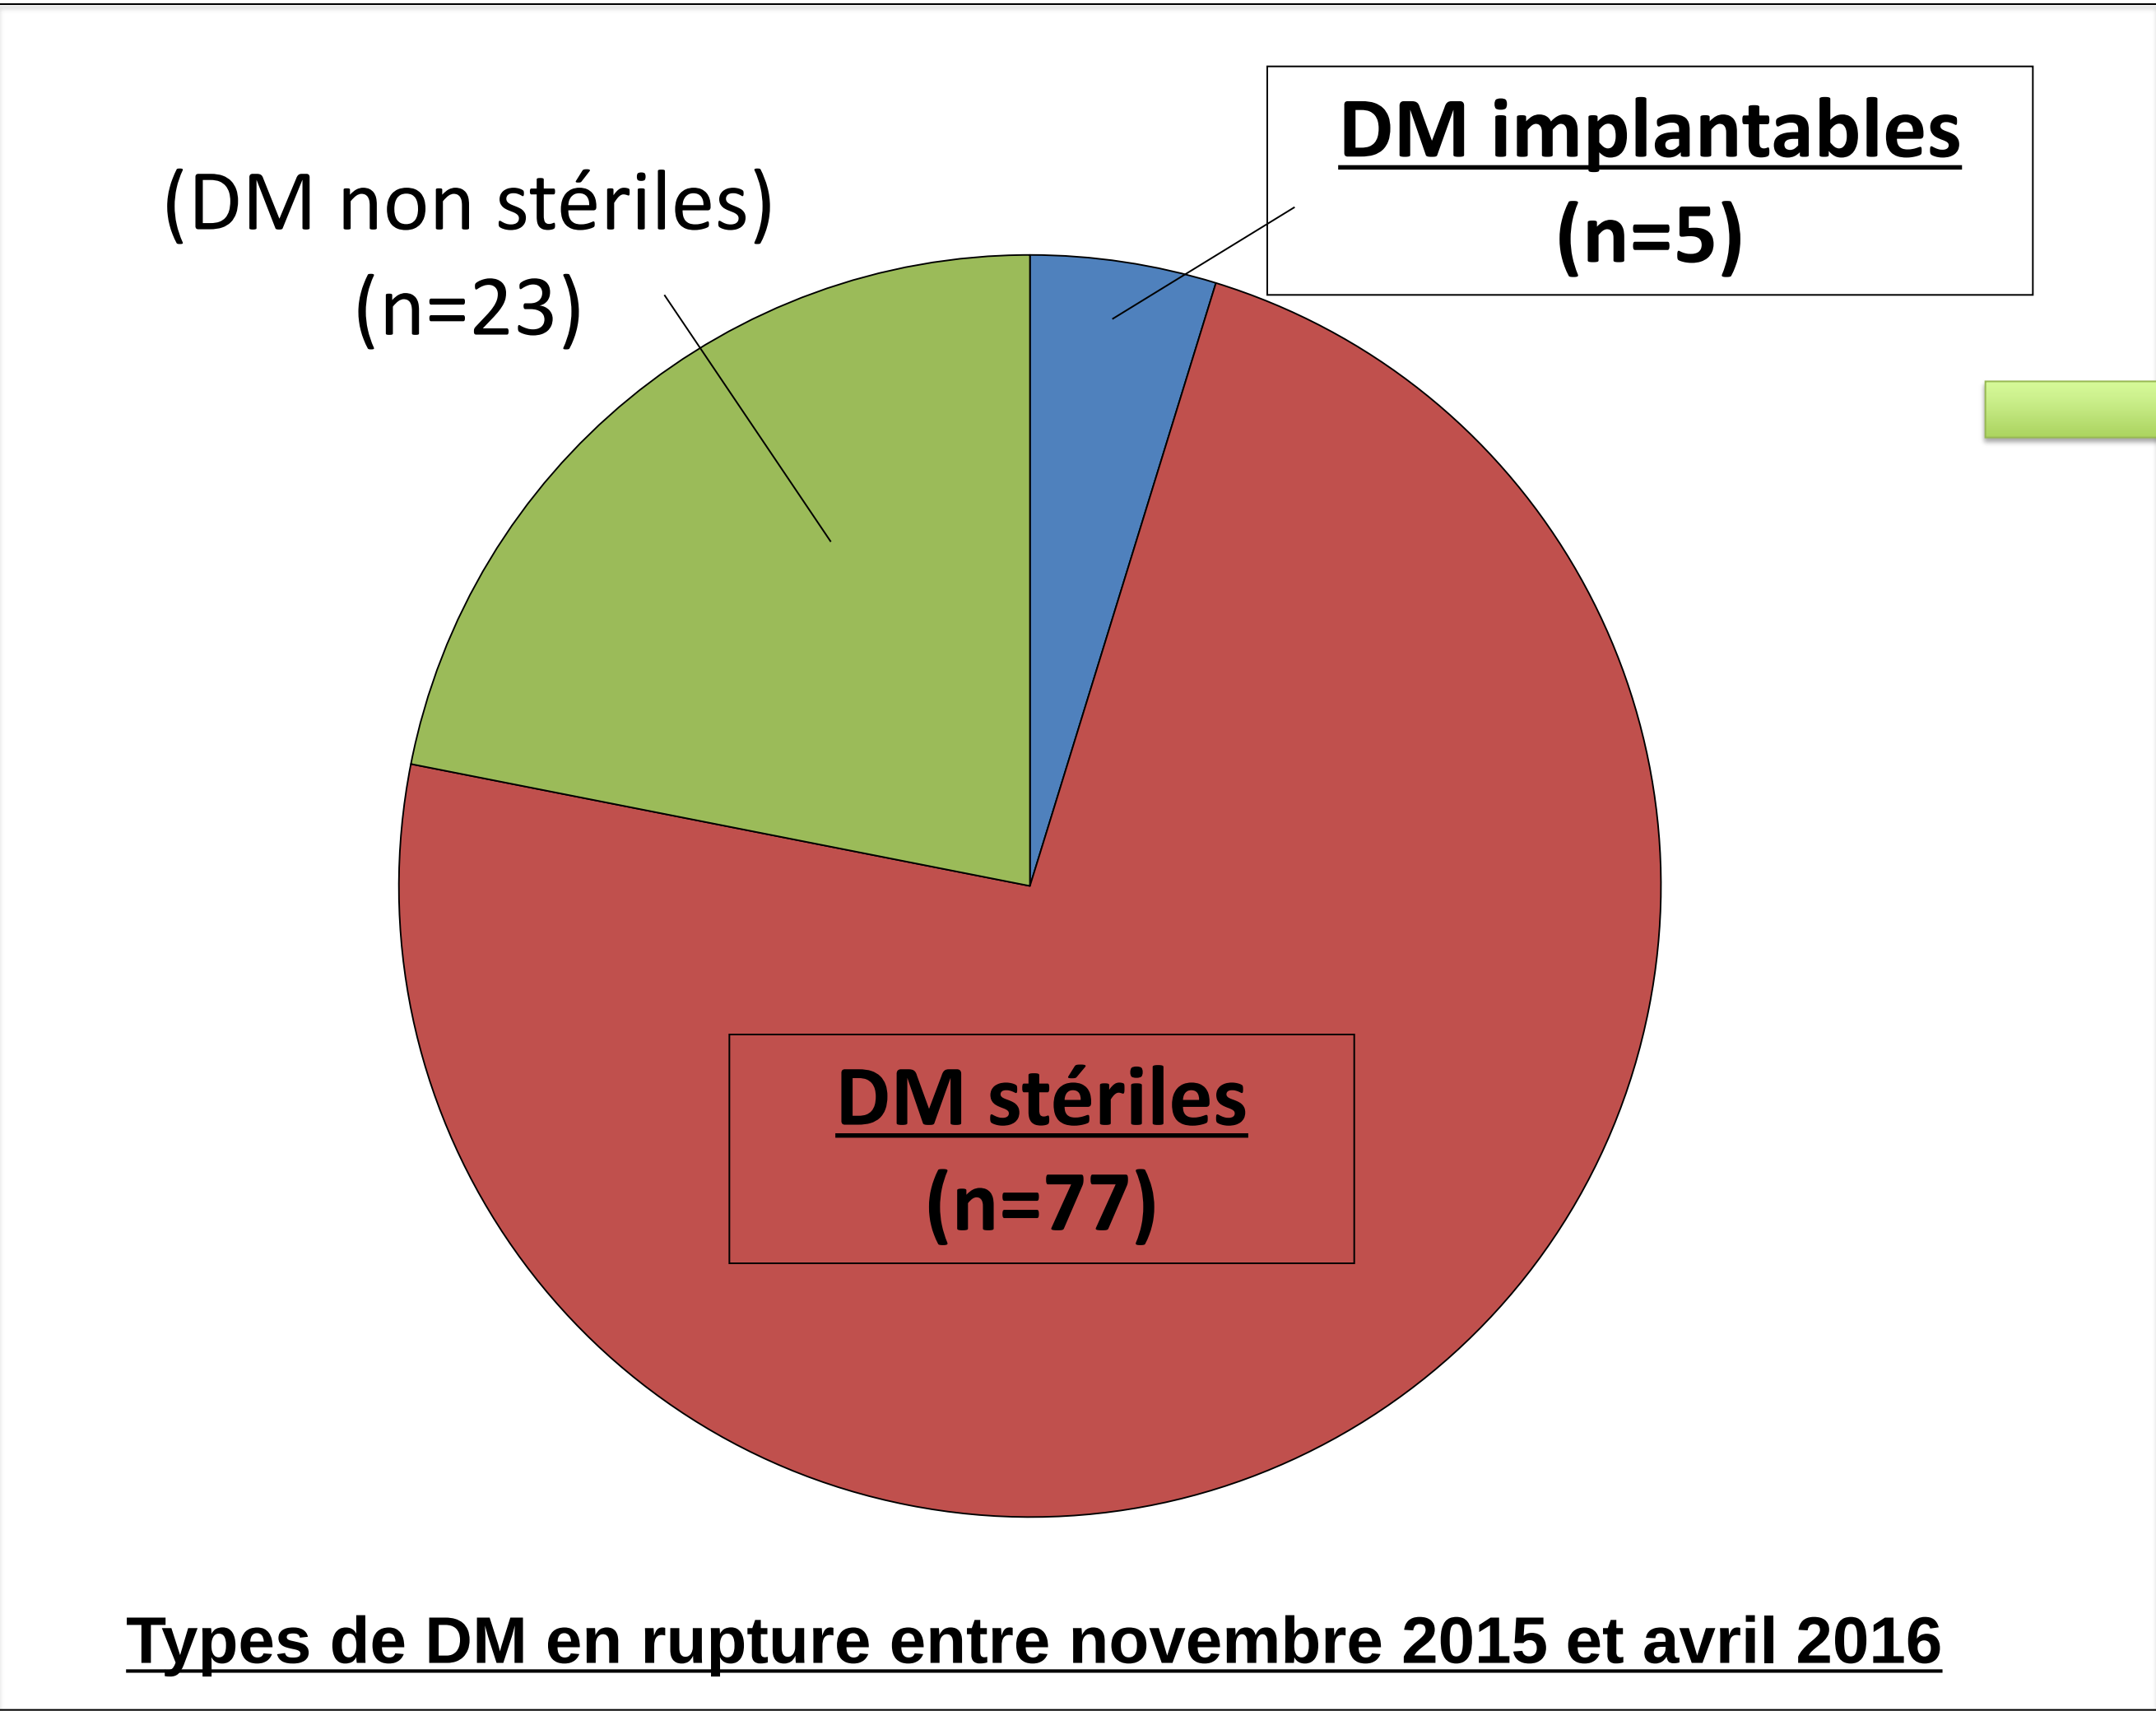

En excluant de l'analyse les ruptures de DM non stériles, une référence a été validée en alternative dans 61% des cas :

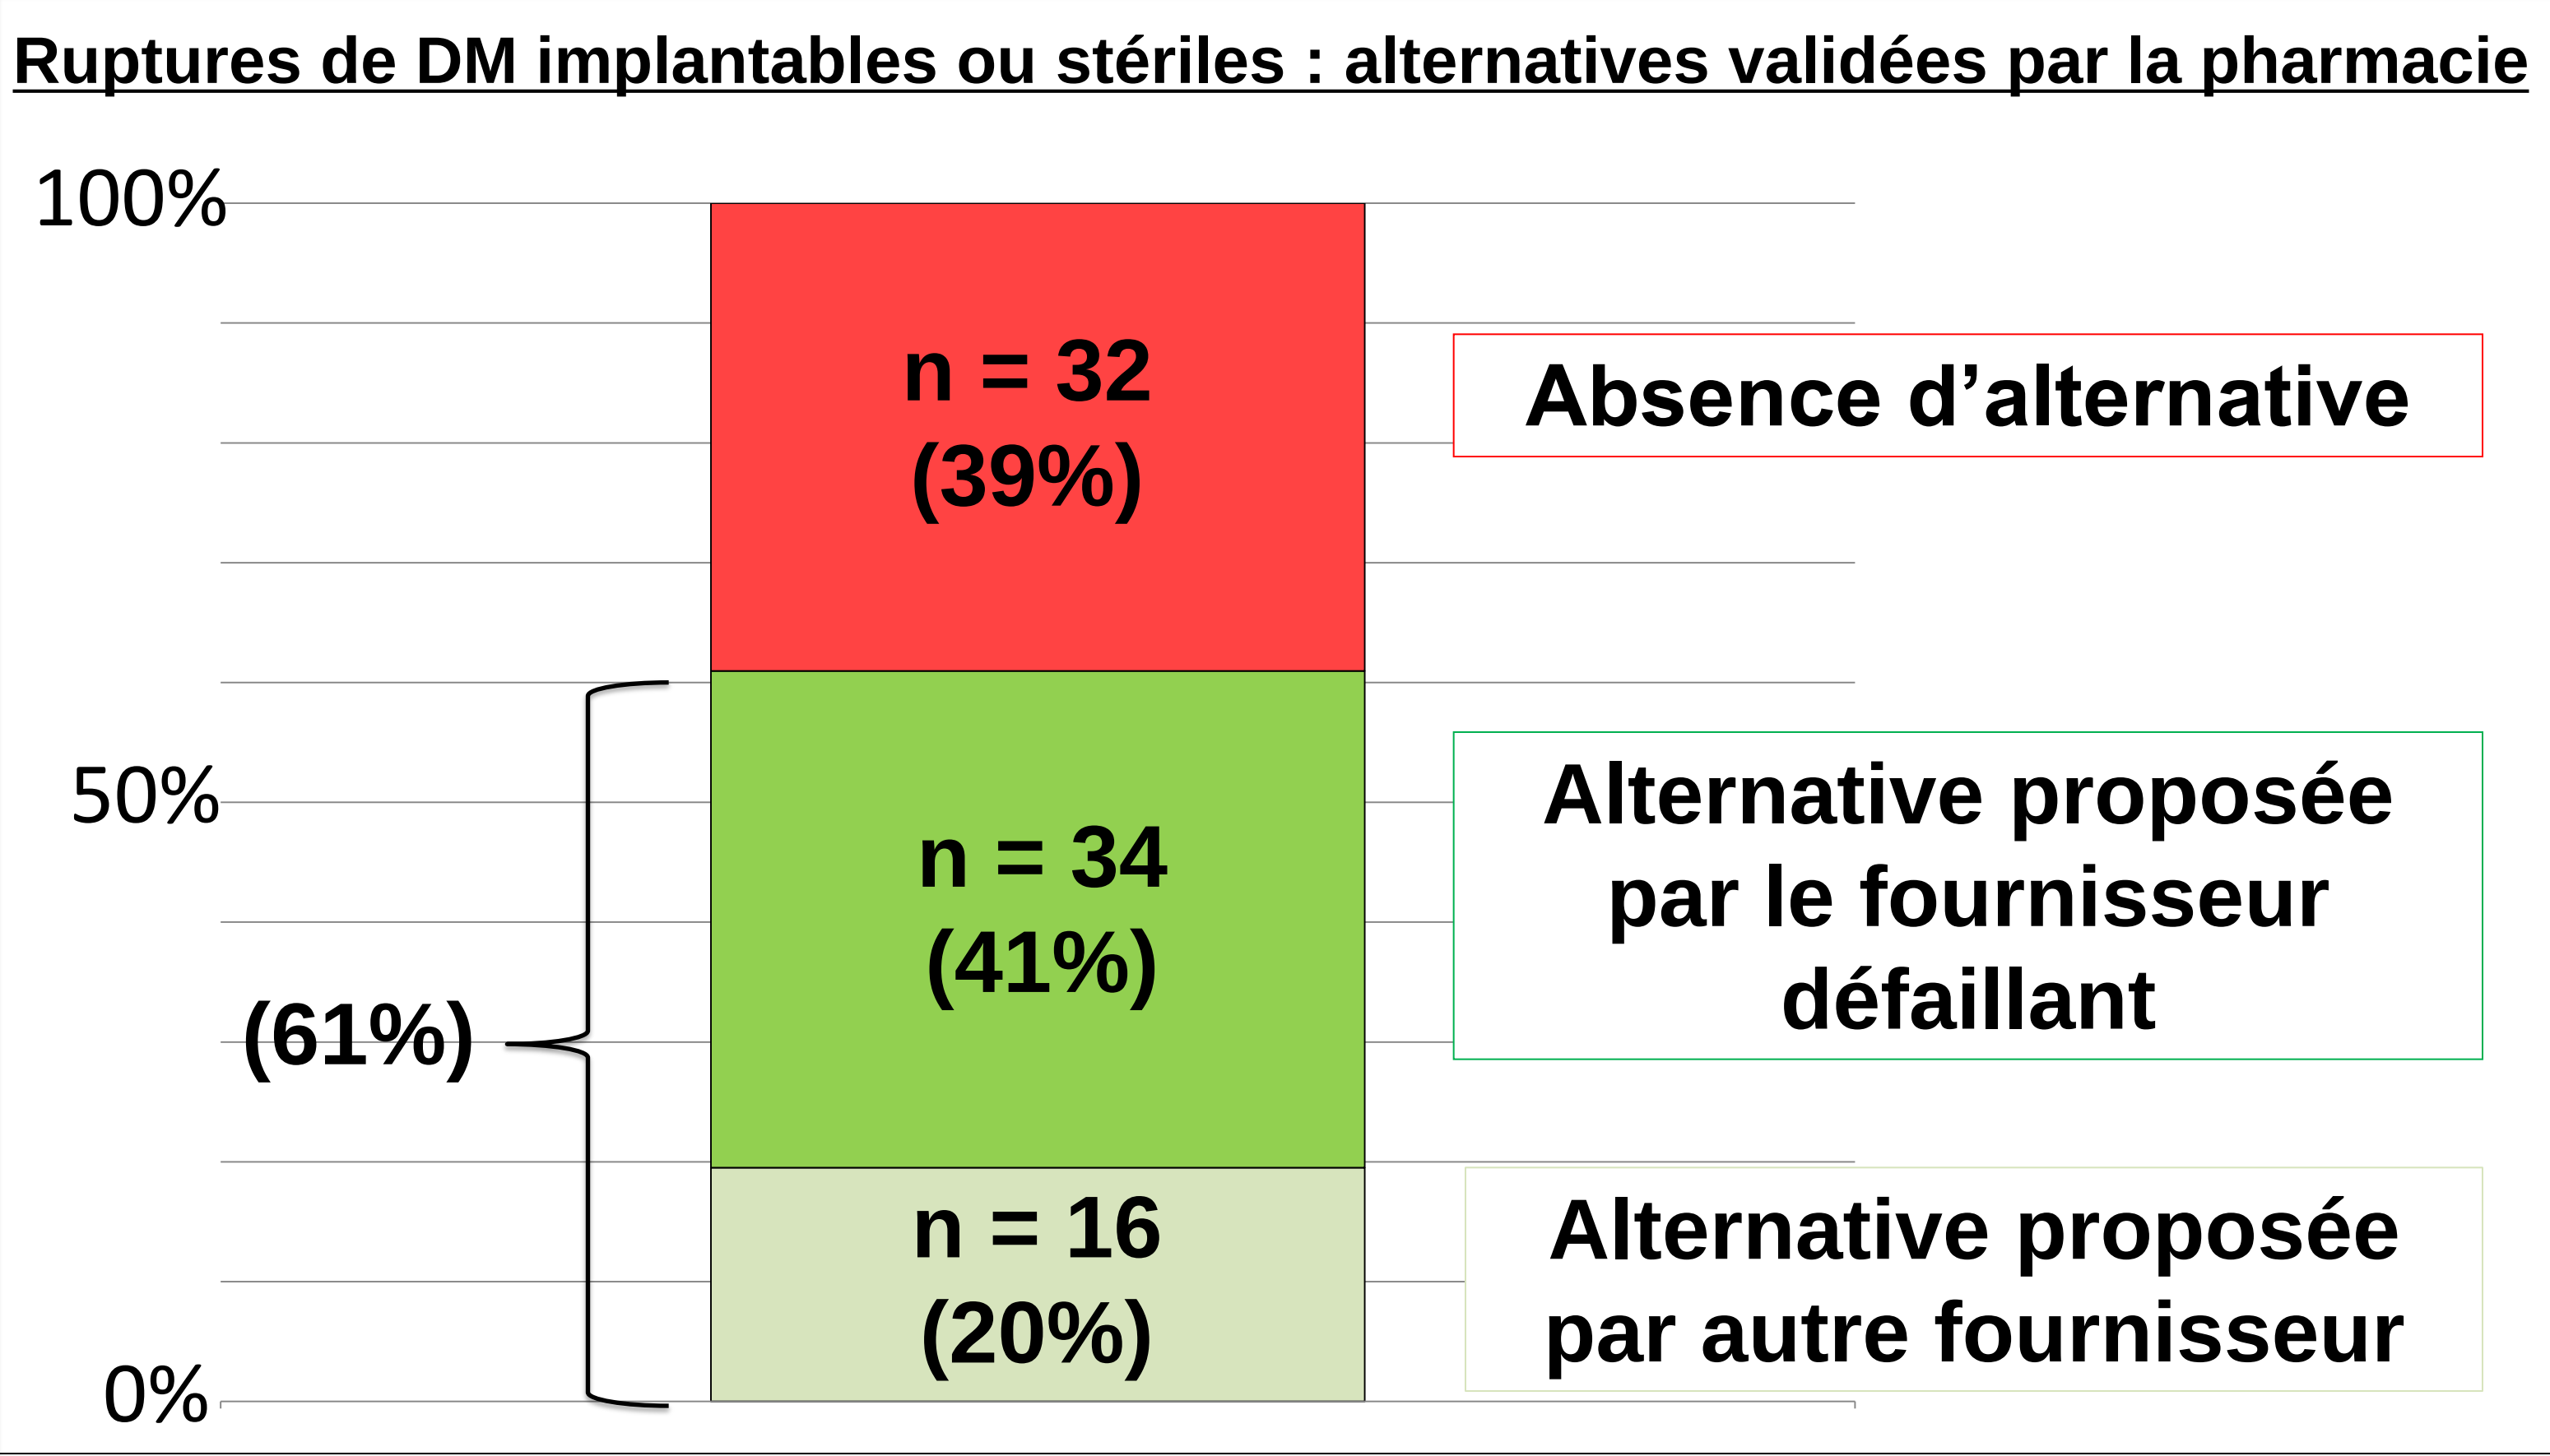

Durée moyenne d'une rupture : **42,5 jours [6j – 141j]**

Durée de la rupture initialement annoncée par le fournisseur :

→ **33% des cas (n=27)** :

✓ **aucun délai** de fin de rupture initialement annoncé par le fournisseur

→ **Autres cas (n=55)** :

✓ la différence moyenne entre le délai initialement prévu et le délai réel de remise à disposition était de **+ 0,14 jours +/- 18 [-37j ; +69j]**

CONCLUSION

- Cette analyse permet d'objectiver le **nombre important** actuel de ruptures de DM
- La gestion de ces ruptures inclut la validation d'une **solution de dépannage** et la **diffusion de l'information aux services utilisateurs**
- Cependant dans certaines situations, le fournisseur défaillant ne propose pas d'alternative et/ou ne précise pas de délai de fin de rupture, ce qui en **complexifie la gestion et le suivi**