

RUPTURES EN DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES : BILAN DE L'ANNEE 2023

L. CLARETON¹, M. COSSON¹, V. PEPE¹, A. BROS¹, S. WISNIEWSKI¹, B. GOURIEUX¹

¹Hôpitaux Universitaire de Strasbourg – Strasbourg (France)


laure.clareton@chru-strasbourg.fr

Mots clés : approvisionnement, impact, pratiques

INTRODUCTION

Chronophage, la gestion des ruptures d'approvisionnement des dispositifs médicaux stériles (DMS) est devenue une activité de routine au fil des années afin d'assurer la continuité des soins des patients (903 ruptures en 2020 vs 1897 ruptures en 2023).

OBJECTIF

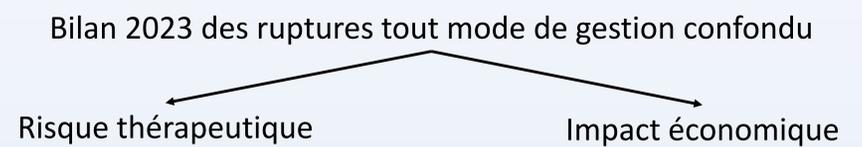


MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les informations concernant les ruptures sont collectées dans un fichier Excel[®] : référence, fournisseur, mode de gestion (stock ou hors-stock), substitution mise en place, différence économique et communication réalisée auprès des unités de soins notamment sur les différences techniques. Nous avons analysé ces données sur l'année 2023.


RÉSULTATS

Nombre de ruptures et mode de gestion

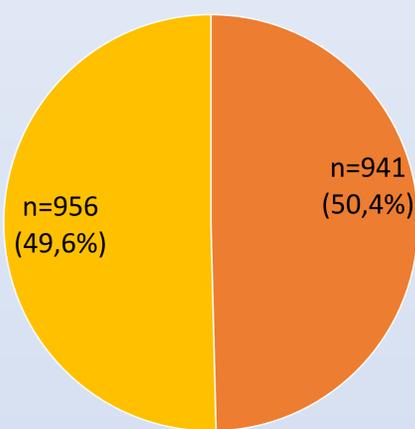


■ DMS gérés en stock ■ DMS gérés en hors-stock

Nombre de ruptures avec mise en place d'une alternative et d'un achat pour compte

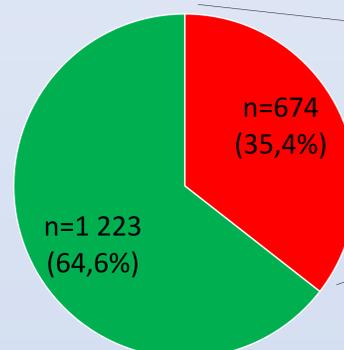

■ Stock insuffisant
■ Stock suffisant (pharmacie ou unité de soin)

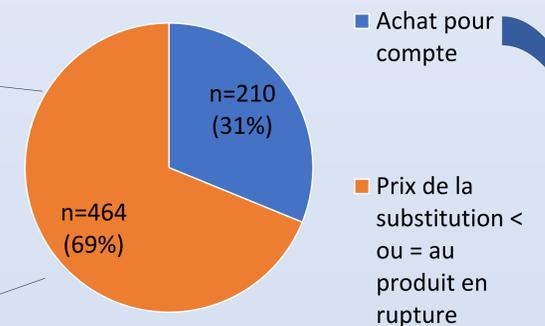

Montant total lié aux achats pour compte = 249 000€
(environ 0,4% des achats de DM en 2023)

Communication réalisée :

→ 565 (83,8%) notes d'informations ont été envoyées aux utilisateurs

Impacts et conséquences :

→ 369 (65,3%) notes d'informations rapportaient des différences techniques dont 121 (32,8%) différences majeures et/ou engendrant un **changement de pratiques** médicales/paramédicales (ex : *changement de technique de pose (cathéter de dialyse), mise en place d'un nouvel équipement suite rupture de consommables captifs...*)

→ 5 ruptures ont nécessité un **dépannage en urgence** auprès d'un autre établissement (ex : *solution conservation d'organe, perceuse à main...*)

→ 1 rupture a entraîné la **déprogrammation** de patients en l'absence d'alternative possible (ex : *introduceur sonde biopsie sous IRM encor senorx®*)

Augmentation du nombre de ruptures : **+204,5%** depuis 2019.

DISCUSSION / CONCLUSION

Les ruptures d'approvisionnement des DMS impactent la continuité des soins. En 2023, **32,8% des ruptures avec changement de référence ont entraîné une différence de pratiques médicales/paramédicales**. Le personnel pharmaceutique mobilisé est multiple (internes, pharmaciens, préparateurs, agents administratifs) et la sollicitation des services de soins est importante afin de gérer et limiter ces situations tant d'un point de vue thérapeutique et de bon usage qu'économique.